

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ 8470000159/2565

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เลขที่ 888 หมู่ที่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โอлимпัส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคาร เอ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวสิริกานต์ เปี่ยมสัมฤทธิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E10091220417926 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และ หนังสือมอบอำนาจช่วง ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีชนิดวิดีโอทัศน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด เป็นราคาทั้งสิ้น 1,880,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 122,990.65 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ 2 การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย


ข้อ 3 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 ผผนวก 1 รายการคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	3	หน้า
3.2 ผผนวก 2 แค็ตตาล็อก	จำนวน	34	หน้า
3.3 ผผนวก 3 ใบเสนอราคา	จำนวน	3	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญา

บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น



ข้อ 4 การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ 5 การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ 6 การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกอโศก ชื่อบัญชี บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี 109-1-17450-3 ทั้งนี้ ผู้ขายตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ 7 การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้
ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อที่มีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือ
ให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความ
รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อที่มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 8 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 21/1357 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 94,000.00 บาท
(เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของ
ผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง
ความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้
ระยะเวลาการส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อ
ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้น
จากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 9 การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว
หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๘ เป็น
จำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือ
เฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายใน 3 (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดเชยราคาที่
ผู้ซื้อเพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย



ข้อ 10 ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตาม ข้อ 9 ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดสอง (0.2%) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังมิได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ 8 กับเรียกร้องให้ชดเชยราคาที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 11 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ 12 การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



ข้อ 13 การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญา เป็นสิ่งของของผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริกานต์ เปี่ยมสัมฤทธิ์)

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัฒน์ ทองเรือง)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีชนิดวิดีโอทัศน
ตำบลศัลยา อำเภอยุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

1. ความต้องการ

ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีชนิดวิดีโอทัศน จำนวน 1 ชุด

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เพื่อการตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน มีเลนส์มองภาพอยู่ที่ส่วนปลายกล้อง ซึ่งเห็นภาพด้านข้าง การใช้งานต่อเข้ากับเครื่องประมวลสัญญาณภาพวิดีโอทัศน

3. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวิดีโอทัศน ใช้เพื่อการตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน มีเลนส์มองภาพอยู่ที่ส่วนปลายกล้อง ซึ่งเห็นภาพด้านข้าง การใช้งานต่อเข้ากับเครื่องประมวลสัญญาณภาพวิดีโอทัศน และแสดงภาพการตรวจรักษาเป็นลักษณะทกเหลี่ยมบนจอมอนิเตอร์

4. คุณลักษณะเฉพาะ

4.1. ระบบเลนส์

4.1.1. มุมมองภาพไม่น้อยกว่า	100 องศา
4.1.2. เห็นภาพชัดในระยะระหว่าง	5-60 มม.
4.1.3. ทิศทางการมองภาพแบบ Backwards ไม่น้อยกว่า	15 องศา

4.2. ส่วนใช้งาน

4.2.1. ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า	13.4 มม.
4.2.2. แสดงภาพแปดเหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน	11.3 มม.
4.2.3. ความยาวใช้งานกล้องไม่เกิน	1,240 มม.
4.2.4. ความยาวรวมกล้องไม่เกิน	1,560 มม.
4.2.5. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่เครื่องมือ	4.2 มม.

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


นายแพทย์อนุชิต เลิศศิริธง

แพทย์ศัลยศาสตร์



4.3. ส่วนปรับมุมสามารถปรับมุมได้ 4 ทิศทาง

4.3.1. ปรับมุมขึ้นได้	120 องศา
4.3.2. ปรับมุมลงได้	90 องศา
4.3.3. ปรับมุมทางขวา	110 องศา
4.3.4. ปรับมุมทางซ้ายได้	90 องศา

4.4. มีกลไกที่สามารถยึดลวดนำ (Guidewire Locking) ให้อยู่กับที่บริเวณปลายกล้องแบบ Dual System

4.5. สามารถตัดคลื่นแสงจำเพาะในการดูรอยโรคที่ผิดปกติได้โดยใช้ระบบ (Narrow Band Imaging(NBI)

4.6 การต่อใช้งานกับเครื่องมีลักษณะเป็น Waterproof One-touch Connector ทำให้สะดวกรวดเร็วในการจัดเตรียมและใช้งาน และยังออกแบบมาให้สามารถกันน้ำได้ เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายกับตัวกล้องจากการสัมผัสของเหลว

4.7 มีระบบ High Force Transmission ช่วยให้แพทย์สามารถทำหัตถการง่ายมากยิ่งขึ้น

5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการสาธิตหรือถูกใช้งานมาก่อน

5.2. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี อันเกิดจากความบกพร่องจากการใช้งานปกติ

5.3. ระหว่างการรับประกัน บริษัทต้องเข้ามาบำรุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องมือ อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง

5.4 ในระยะเวลาประกัน หากเครื่องเกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ทางบริษัทจะนำเครื่องสำรองมาให้ใช้ทดแทนจนกว่าจะสามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

5.5 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด


5.6 ทางบริษัทต้องให้การอบรมผู้ใช้เครื่อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถใช้เครื่องได้

5.7 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา



5.8 รายละเอียดนี้เป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสุด คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

5.9 ทางศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอสิทธิ์ในการทดสอบครุภัณฑ์ภายหลังการส่งมอบเป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือทดสอบกับการใช้ครุภัณฑ์กับผู้ป่วยอย่างน้อยจำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในระหว่างทดสอบ หากครุภัณฑ์ดังกล่าวมีปัญหาไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางผู้ขายจะต้องจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อนที่มีประสิทธิภาพเท่าหรือดีกว่ามาติดตั้งแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



นายแพทย์อนุชิต เลิศศิริวง
แพทย์ศัลยศาสตร์

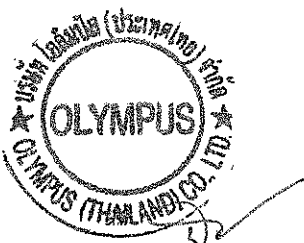


5.10 ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบแล้ว รายการ ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีชนิดวิดีโอทัศน์ ไม่มีพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย

5.11 กำหนดส่งของภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบสั่งซื้อ



ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

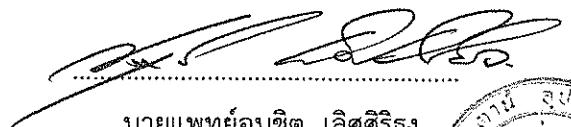

นายแพทย์อนุชิต เลิศศิริธง
แพทย์ศัลยศาสตร์



OLYMPUS

Your Vision, Our Future

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีชนิดวิดีโอทัศน

1. ความต้องการ

ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีชนิดวิดีโอทัศน รุ่น TJF-Q190V จำนวน 1 ชุด

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เพื่อการตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน มีเลนส์มองภาพอยู่ที่ส่วนปลายกล้อง ซึ่งเห็นภาพด้านข้าง
การใช้งานต่อเข้ากับเครื่องประมวลสัญญาณภาพวิดีโอทัศน

3. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวิดีโอทัศน ใช้เพื่อการตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน มีเลนส์มอง
ภาพอยู่ที่ส่วนปลายกล้อง ซึ่งเห็นภาพด้านข้าง การใช้งานต่อเข้ากับเครื่องประมวลสัญญาณภาพวิดีโอทัศน และ
แสดงภาพการตรวจรักษาเป็นลักษณะทกเหลี่ยมบนจอมอนิเตอร์

4. คุณลักษณะเฉพาะ

4.1. ระบบเลนส์


4.1.1. มุมมองภาพ	100 องศา
4.1.2. เห็นภาพชัดในระยะระหว่าง	5-60 มม.
4.1.3. ทิศทางการมองภาพ Backwards	15 องศา

4.2. ส่วนใช้งาน

4.2.1. ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	13.5 มม.
4.2.2. แสดงภาพแปดเหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก	11.3 มม.
4.2.3. ความยาวใช้งาน	1,240 มม.
4.2.4. ความยาวรวม	1,560 มม.
4.2.5. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่เครื่องมือ	4.2 มม.

4.3. ส่วนปรับมุมสามารถปรับมุมได้ 4 ทิศทาง

4.3.1. ปรับมุมขึ้นได้	120 องศา
4.3.2. ปรับมุมลงได้	90 องศา

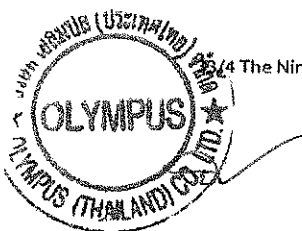

OLYMPUS (THAILAND) CO., LTD.

4 The Ninth Towers, Tower A, 32nd Floor, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand Tel +66 2000 7700 Fax +66 2000 7711
ISO 9001 certified by Bureau Veritas Certification with UKAS and NAC accreditation.



OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

- 4.3.3. ปรับมุมทางขวา 110 องศา
- 4.3.4. ปรับมุมทางซ้ายได้ 90 องศา
- 4.4. มีกลไกที่สามารถยึดลวดนำ(Guidewire Locking)ให้อยู่กับที่บริเวณปลายกล้องแบบ Dual System
- 4.5. สามารถตัดคลื่นแสงจำเพาะในการดูรอยโรคที่ผิดปกติได้โดยใช้ระบบ Narrow Band Imaging(NBI)
- 4.6. การต่อใช้งานกับเครื่องมือมีลักษณะเป็น Waterproof One-touch Connector ทำให้สะดวกรวดเร็วในการจัดเตรียมและใช้งาน และยังออกแบบมาให้สามารถกันน้ำได้ เพื่อความสะดวกในการทำทำความสะอาด และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายกับตัวกล้องจากการสัมผัสของเหลว
- 4.7. มีระบบ High Force Transmission ช่วยให้แพทย์สามารถทำหัตถการง่ายมากยิ่งขึ้น

5. เงื่อนไขเฉพาะ


- 5.1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการสาธิตหรือถูกใช้งานมาก่อน
- 5.2. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี อันเกิดจากความบกพร่องจากการใช้งานปกติ
- 5.3. ระหว่างการรับประกัน บริษัท ต้องเข้ามาบำรุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องมือ 6 เดือนต่อครั้ง
- 5.4. ในระยะเวลาประกัน หากเครื่องเกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติทางบริษัทจะนำเครื่องสำรองมาให้ใช้ทดแทนจนกว่าจะสามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
- 5.5. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
- 5.6. ทางบริษัทต้องให้การอบรมผู้ใช้เครื่อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถใช้เครื่องได้
- 5.7. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา
- 5.8. รายละเอียดนี้เป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสุด คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
- 5.9. ทางศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอสิทธิ์ในการทดสอบครุภัณฑ์ภายหลังการส่งมอบเป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือทดสอบกับการใช้ครุภัณฑ์กับผู้ป่วยจำนวน 2 ครั้งทั้งนี้ ในระหว่างทดสอบ หากครุภัณฑ์ดังกล่าวมีปัญหาไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางผู้ขายจะต้องจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อนที่มีประสิทธิภาพเท่าหรือดีกว่ามาติดตั้งแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
- 5.10. ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบแล้ว รายการ ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีชนิดวิดีโอทัศน ไม่มีส่วนที่ผลิตภายในประเทศไทย
- 5.11. กำหนดส่งของภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบสั่งซื้อ



OLYMPUS (THAILAND) CO., LTD.

32nd The Ninth Towers, Tower A, 32nd Floor, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand Tel +66 2000 7700 Fax +66 2000 7711

ISO 9001 certified by Bureau Veritas Certification with UKAS and NAB accreditation.

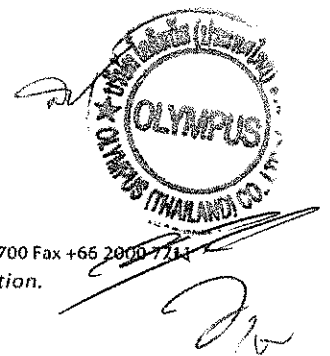

หน้า 2 หน้า 3/34
เลขที่ 8470000759


OLYMPUS

EVIS EXERA III

EVIS EXERA III DUODENOVideoscope

TJF-Q190V

Supporting Your Standard of Care

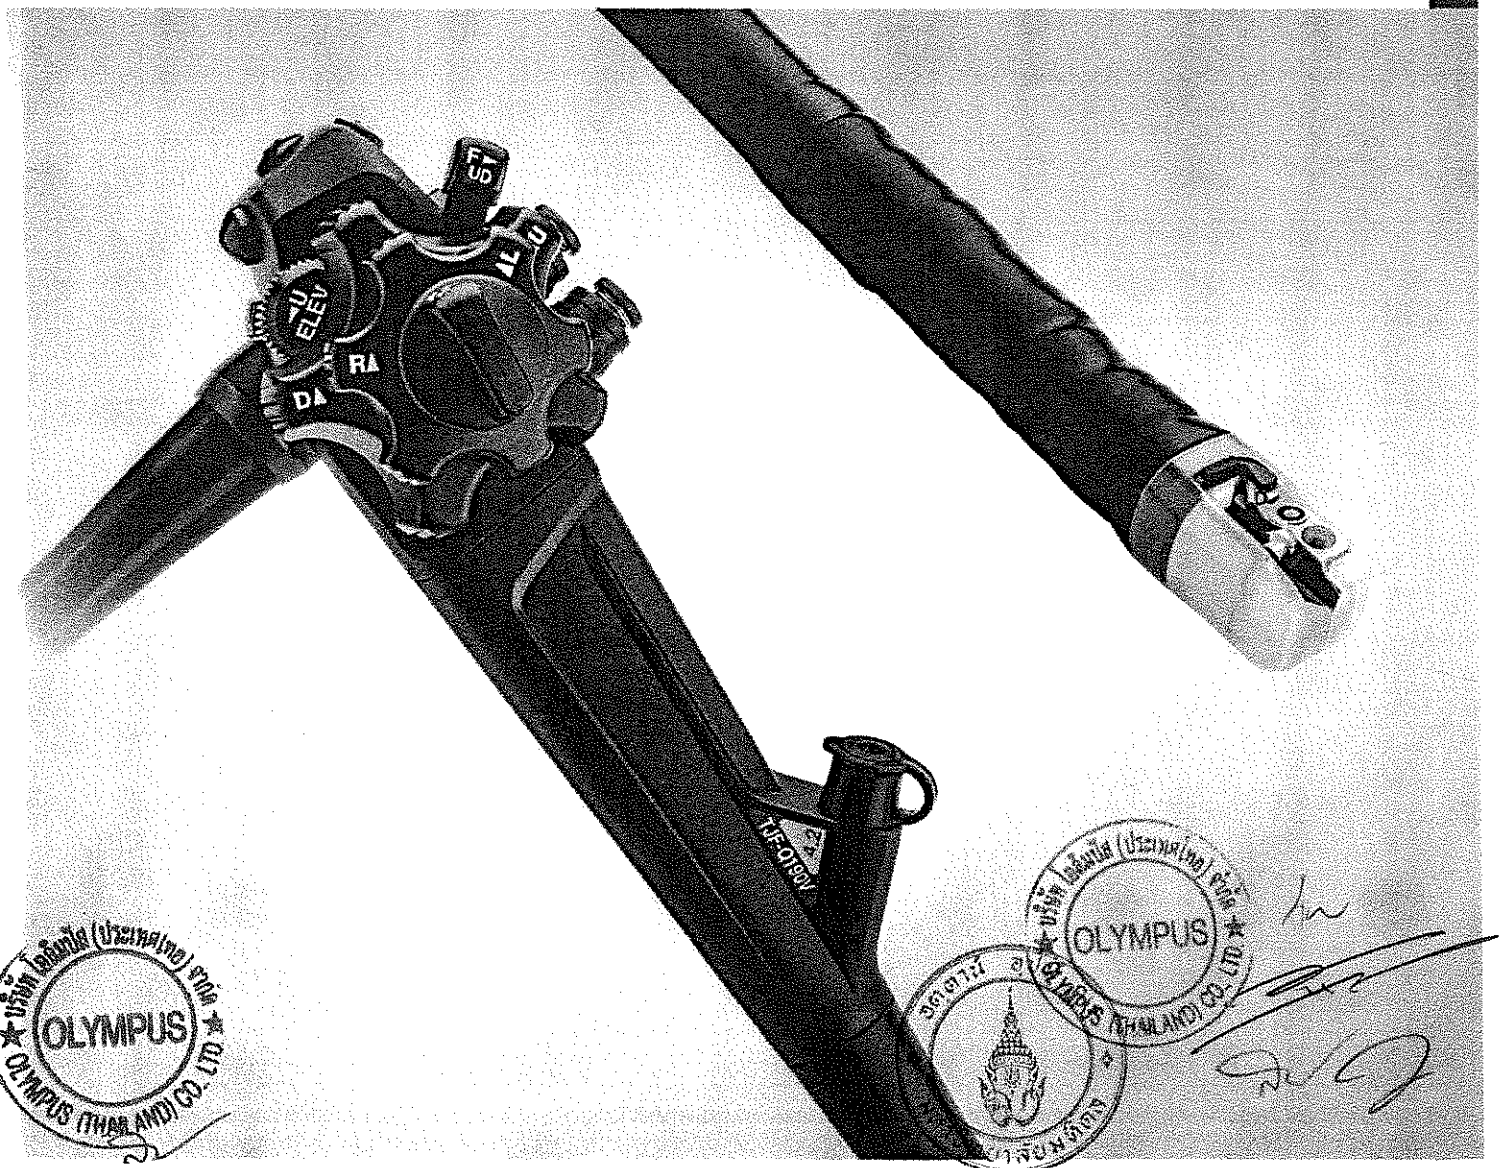

TJF-Q190V DUODENOVideoscope

Supporting Your Standard of Care



ERCP Solutions That Allow You to Focus on Your Patient

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) procedures are highly challenging for all parties involved: gastroenterologists, nurse managers, reprocessing technicians, and hospital administrators. Most of all, it is a difficult time for your patient, both physically and mentally.

Leading up to the ERCP procedure, your patient and their family have already been through a long and taxing medical journey. There is a lot of uncertainty about what lies ahead, and they are counting on your team to help them through the process. The technical aspects of the procedure aren't necessarily top-of-mind for your patients in these moments. Rather, their questions are likely to be:

"Will this procedure be painful?"
 "Will I get the answers I am looking for?"
 "Will you be able to help me get better?"
 "What is my prognosis?"


The first generation of Olympus duodenoscopes, combined with our unique guidewire and sphincterotome technologies, is designed to provide a comprehensive solution to nearly all ERCP access procedures.

Helping Gastroenterologists Provide Quality Care

When performing an ERCP, you need tools and techniques that you can trust so you can focus on taking care of your patients. The Olympus TJF-Q190V duodenovideoscope has maneuverability and imaging capabilities to help you serve your patients and get the answers they need. With proven ERCP solutions, you can rest assured that you have the complete tool set you need to provide the care your patients deserve.

Our high quality imaging delivers sharp, clear images for easy viewing and observation during the procedure.

The new TJF-Q190V utilizes a square image shape and 15° backward viewing, allowing for expanded vertical field of view and improving cannulation efficiency. You can continue to rely on dual guidewire locking system at the distal end, enabling locking of 0.035 inch and 0.025 inch guidewires.

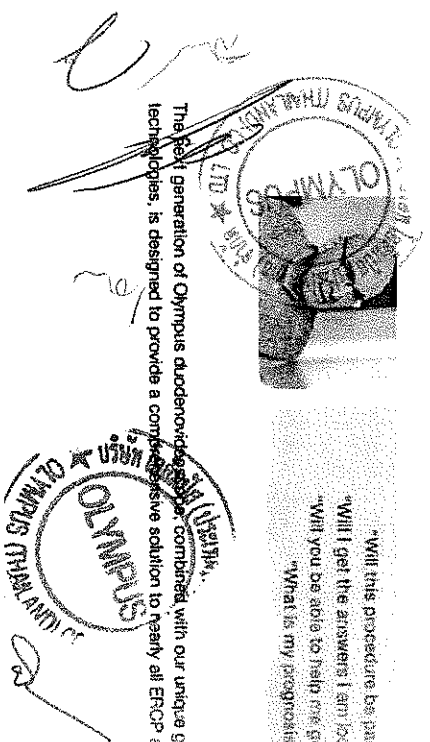


TJF-Q190V DUODENOVideoscope

Supporting Your Standard of Care

Supporting Nurse Managers and Their Teams

Nurse managers are ultimately responsible for overseeing effective and thorough reprocessing of duodenoscopes, a critical component of patient safety before and after an ERCP procedure.

The single-use distal cover is designed for improved visualization of the distal end and reprocessing.

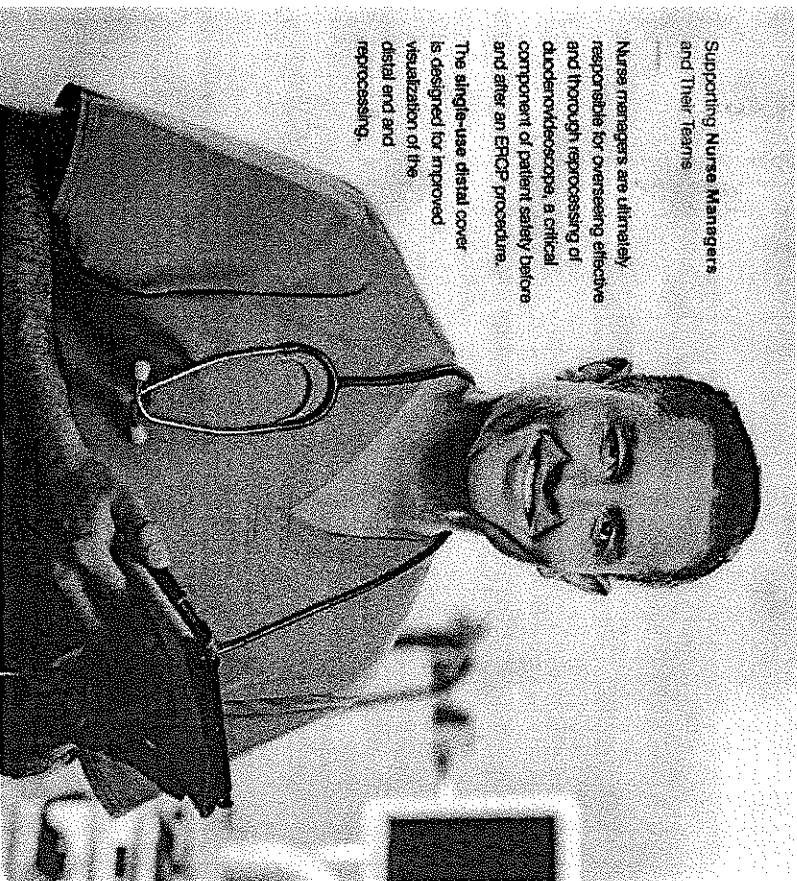

Our Newest Duodenovideoscope Offers the Following Features:

Single-use distal cover for improved visualization of the distal end and reprocessing.



Expanded field of view with a square display.

- Extended view area of TJF-Q190V
- New area of TJF-Q180V




Providing Hospital Administrators Safe & Effective Tools

The Olympus TJF-Q190V duodenovideoscope provides the latest advancements in ERCP technology to satisfy your physicians, as well as a design meant to provide efficient reprocessing to meet the needs of your nurse managers.

You can rely on Olympus field service and clinical support to ensure that you team is well-prepared and has all of the tools they need for success.



Guidewire locking capability to facilitate 0.035 inch and 0.025 inch short guidewire locking.



High-quality imaging capabilities for viewing and observation.



Page 2 of 5
8470000159

TJF-Q190V DUODENOVideoscope

Features and Benefits

Single-use Distal Cover
Allows for visualization of distal end and access for reprocessing.

Guidewire Locking
Facilitate short guidewire locking with dual system at the distal end.

Improved Cannulation Efficiency
Square image shape and 15° backward viewing allow for expanded vertical field of view.


Distal-end Flushing Adaptor
Designed for directed flushing during manual cleaning.

Waterproof One-touch Connector
190-series scopes allow a one-step connection to the video system.



High Force Transmission (HFT)
HFT, the scope handling technology designed to improve scope responsiveness and ergonomics in 190-series colonoscopes, is now incorporated into the TJF-Q190V.

Narrow Band Imaging (NBI)
NBI with the EVIS EXERA II system is significantly brighter than with the EVIS EXERA II System.

Overall Image Quality
The EVIS EXERA II System and endoscopes provide superior image quality. EVIS EXERA II System and endoscopes.

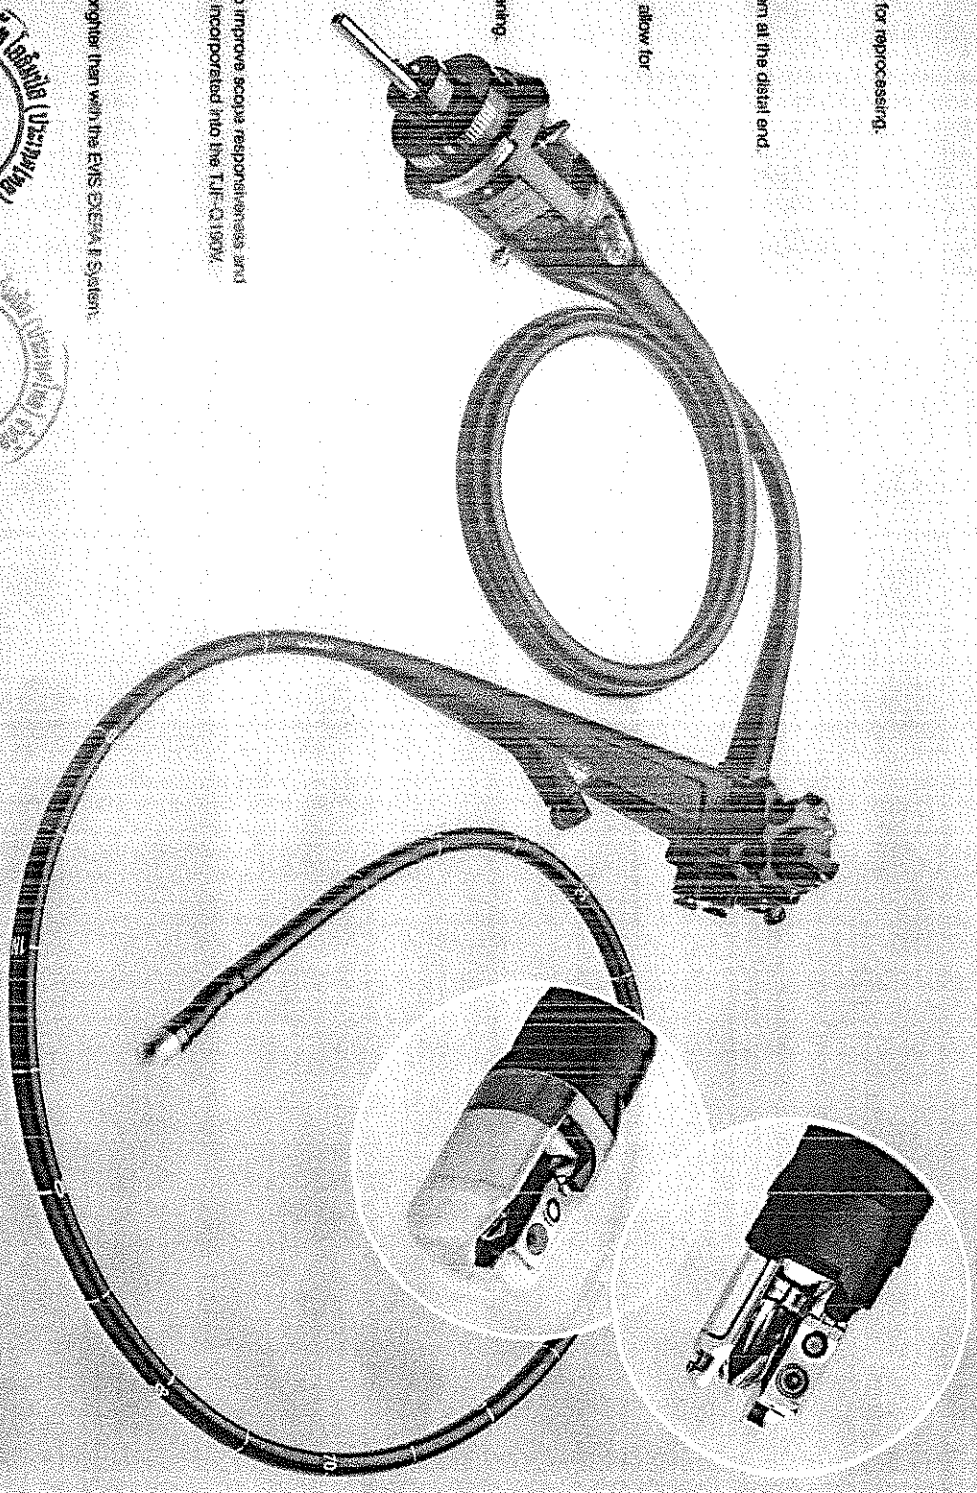

EVIS EXERA II DUODENOVideoscope Olympus TJF-Q190V

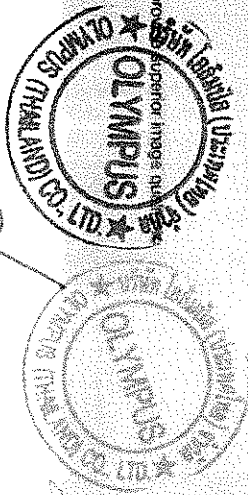


เลขที่ 2
วันที่ 6/34
สัญญาเลขที่ 8470000159

TJF-Q190V DUODENOVideoscope

Supporting Your Standard of Care

Olympus takes our role in enhancing patient safety very seriously. We are continuously seeking to improve the next generation of our products, provide guidance on their safe and effective use and increase the ease and efficacy of endoscope reprocessing.



Our ultimate goal is not to control infections potentially associated with endoscopy but to prevent them.

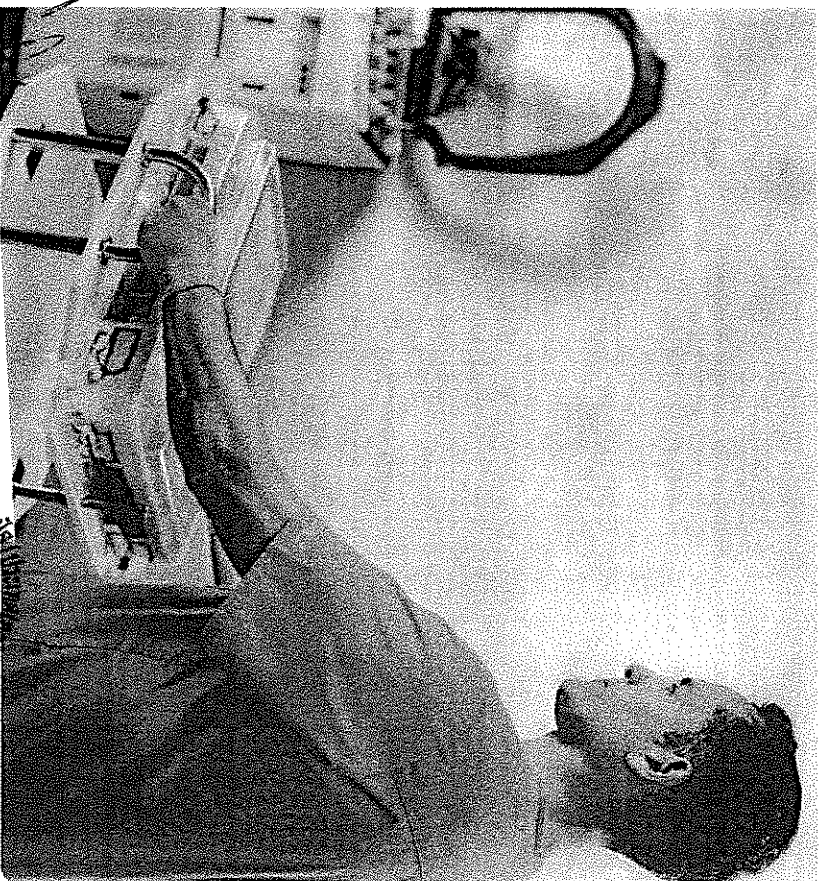

Providing Technicians with Access


Reprocessing technicians are charged with a critical responsibility: reprocessing duodenovideoscopes for ERCP procedures. Patients face potential risks with any medical procedure, which may add to their stress. Technicians want to do what they can to reduce these concerns, including working to avoid potential infections associated with ERCP.

The Olympus TJF-Q190V has features that are designed with Technicians in mind.

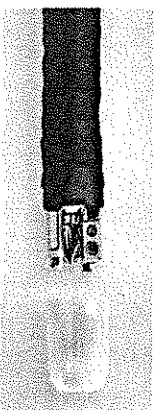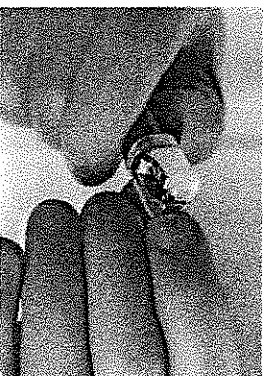


Single-use Distal Cover
Designed to provide access for brushing and flushing.

Distal-end Flushing Adapter
Designed to direct flushing during manual cleaning.

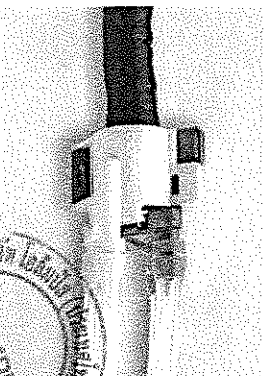


2 7/34
84/0000159



TJF-Q190V

Product Specifications

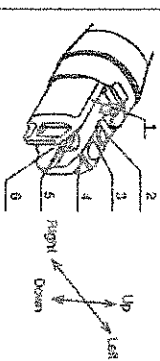Optical System	Field of View	100°	4:1:1
	Direction of View	Backward side viewing 15°	4:1:3
	Depth of field	5 to 60 mm	4:1:2
Insertion Section	Distal end enlarged 1. Instrument channel outlet 2. Air/Water nozzle 3. Objective lens 4. Light guide lens 5. Forceps elevator 6. Guidewire-locking groove		
			
	Insertion tube outer diameter	11.5 mm	4:2:2
	Distal end outer diameter	13.5 mm	4:1:1
	Working length	1240 mm	4:2:3
	Channel inner diameter	4.2 mm	4:2:5
Instrument Channel	Minimum visible distance	10 mm	
	Direction from which EndoTherapy accessories enter and exit the endoscopic image		
	Bending Section	Angulation range Up 120° Down 90° Right 110° Left 90°	4:2:1 4:3:2 4:3:3 4:2:4
Total Length	1500 mm		4:2:4
Compatible EVIS EXERA System			
EVIS EXERA II VIDEO SYSTEM CENTER OLYMPUS CV-160			
EVIS EXERA II XENON LIGHT SOURCE OLYMPUS CLV-100			


Ordering Information

Order Number	Description	Unit	Quantity
TJF-Q190V	190-series Duodenoscope	EA	1 PC
MAJ-2315	Single Use Distal Cover	CAS	20 PC
MAJ-2319	Distal-end Flushing Adapter	EA	1 PC
MAJ-2358	Connecting Tube for OER-Pro / OER-AW	EA	1 PC
MAJ-2350	Connecting Tube for OER-EHE	EA	1 PC


Note

2
 8/34
 8470000159

2 9/34
เลขที่.....
สัญญาฉบับที่..... 8470000159



Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

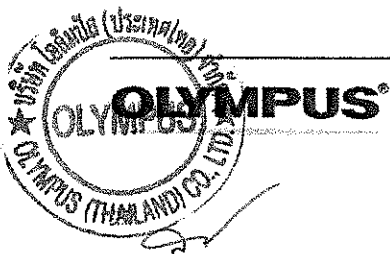


OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.
Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan

For a complete listing of
sales and distribution locations visit
www.olympus.com

[Handwritten signature]
N8601422-032019

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ..ชุดกล้องส่องทางไกลชนิดวีดิทัศน์ ..



ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ	ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา	เอกสารอ้างอิงแผนที่	การยอมรับ (COMPLY)	หมายเหตุ
ชุดกล้องส่องทางไกลชนิดวีดิทัศน์	ญี่ปุ่น	คุณลักษณะทั่วไป	คุณลักษณะทั่วไป	คุณลักษณะทั่วไป			
รุ่น TJF-Q190V		เป็นกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวีดิทัศน์ ใช้เพื่อการตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน มีเลนส์มองภาพอยู่ส่วนปลายกล้อง ซึ่งเห็นภาพด้านข้าง การใช้ทำงานต้องเข้ากับเครื่องประมวลสัญญาณภาพวีดิทัศน์ และแสดงภาพการตรวจรักษาเป็นลักษณะหกเหลี่ยมบนจอมอนิเตอร์	เป็นกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวีดิทัศน์ ใช้เพื่อการตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน มีเลนส์มองภาพอยู่ส่วนปลายกล้อง ซึ่งเห็นภาพด้านข้าง การใช้ทำงานต้องเข้ากับเครื่องประมวลสัญญาณภาพวีดิทัศน์ และแสดงภาพการตรวจรักษาเป็นลักษณะหกเหลี่ยมบนจอมอนิเตอร์				
		คุณลักษณะเฉพาะทาง	คุณลักษณะเฉพาะทาง	คุณลักษณะเฉพาะทาง			
		4.1.ระบบเลนส์	4.1.ระบบเลนส์	4.1.ระบบเลนส์	8		
		4.1.1.มุมมองภาพไม่น้อยกว่า100องศา	4.1.1.มุมมองภาพ100องศา	4.1.1.มุมมองภาพ100องศา	8		
		4.1.2.เห็นภาพชัดในระยะระหว่าง 5-60มม.	4.1.2.เห็นภาพชัดในระยะระหว่าง 5-60มม.	4.1.2.เห็นภาพชัดในระยะระหว่าง 5-60มม.	8		
		4.1.3.ทิศทางการมองภาพ Backwards ไม่น้อยกว่า 15 องศา	4.1.3.ทิศทางการมองภาพ Backwards 15 องศา	4.1.3.ทิศทางการมองภาพ Backwards 15 องศา	8		

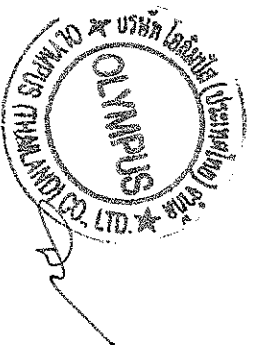

หน้า 1



2 10/34

8470000159




ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ...ชุดกล้องส่องตรวจทางดินน้ำตึชนิดวีดีทัศน์ ..

ลำดับ ที่	ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ชื่อ-รุ่น-แบบ-ขนาด	ผลิตภัณฑ์ ของประเทศ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของผู้เสนอราคา	เอกสารอ้างอิง แผ่นที่	การยอมรับ (COMPLY)	หมายเหตุ
			4.2. ส่วนใช้งาน	4.2. ส่วนใช้งาน	8		
			4.2.1. ส่วนปลายกล้องมีขนาด	4.2.1. ส่วนปลายกล้องมีขนาด	8		
			เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 13.4 มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง 13.5 มม.			
			4.2.2. แสดงภาพแปดเหลี่ยม	4.2.2. แสดงภาพแปดเหลี่ยม	8		
			เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 1.3 มม.	เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 1.3 มม.			
			4.2.3. ความยาวใช้งานไม่เกิน 1,240 มม.	4.2.3. ความยาวใช้งาน 1,240 มม.	8		
			4.2.4. ความยาวรวมไม่เกิน 1,560 มม.	4.2.4. ความยาวรวม 1,560 มม.	8		
			4.2.5. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่ เครื่องมือ 4.2 มม.	4.2.5. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่ เครื่องมือ 4.2 มม.	8		
			4.3. ส่วนรับมุมสามารถปรับมุมได้ 4 ทิศทาง	4.3. ส่วนรับมุมสามารถปรับมุมได้ 4 ทิศทาง	8		
			4.3.1. ปรับมุมขึ้นได้ 120 องศา	4.3.1. ปรับมุมขึ้นได้ 120 องศา	8		
			4.3.2. ปรับมุมลงได้ 90 องศา	4.3.2. ปรับมุมลงได้ 90 องศา	8		
			4.3.3. ปรับมุมทางขวา 110 องศา	4.3.3. ปรับมุมทางขวา 110 องศา	8		
			4.3.4. ปรับมุมทางซ้ายได้ 90 องศา	4.3.4. ปรับมุมทางซ้ายได้ 90 องศา	8		
			4.4. มีกลไกที่สามารถยึดลวดนำ (Guidewire Locking) ให้อยู่กับที่บริเวณปลายกล้อง แบบ Dual System	4.4. มีกลไกที่สามารถยึดลวดนำ (Guidewire Locking) ให้อยู่กับที่บริเวณปลายกล้องแบบ Dual System	6		



หน้า 2 สืบค้นจาก 847000159





ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ..ชุดกล้องส่องทางไกลน้ำตื้นชนิดวิถีทัศน์ ..

ลำดับ ที่	ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ชื่อ-รุ่น-แบบ-ขนาด	ผลิตภัณฑ์ ของประเทศไทย	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของผู้เสนอราคา	เอกสารอ้างอิง แผนที่	การยอมรับ (COMPLY)	หมายเหตุ
		✓	4.5.สามารถตัดคลื่นแสงจำเพาะในการดู รอยโรคที่ผิดปกติได้โดยใช้ระบบ Narrow Band Imaging(NBI)	4.5.สามารถตัดคลื่นแสงจำเพาะในการดู รอยโรคที่ผิดปกติได้โดยใช้ระบบ Narrow Band Imaging(NBI)	6		
		✓	4.6.การต่อใช้งานกับเครื่องมือลักษณะเป็น Waterproof One-touch Connector ทำ ให้สะดวกรวดเร็วในการจัดเตรียมและใช้ งาน และยังออกแบบมาให้สามารถกันน้ำได้ เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความ เสียหายกับตัวกล้องจากการสัมผัสของเหลว	4.6.การต่อใช้งานกับเครื่องมือลักษณะเป็น Waterproof One-touch Connector ทำ ให้สะดวกรวดเร็วในการจัดเตรียมและใช้ งาน และยังออกแบบมาให้สามารถกันน้ำได้ เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความ เสียหายกับตัวกล้องจากการสัมผัสของเหลว	6		
		✓	4.7.มีระบบ High Force Transmission ช่วยให้แพทย์สามารถทำการตรวจอย่าง ยั่งยืน	4.7.มีระบบ High Force Transmission ช่วยให้แพทย์สามารถทำการตรวจอย่าง ยั่งยืน	6		



สนฉา ๒ ๒๕๖๔ ๑๒/๓๔
สัญญาฉบับที่ ๘๔/๒๐๒๒



OLYMPUS

เลขที่ 2 วันที่ 13/31
สัญญาฉบับที่ 8470000159

Date: 11th September, 2020

Certificate of Subsidiary Company

Dear Sir/Madam

We, Olympus Corporation (hereinafter "Olympus") certify that OLYMPUS (THAILAND) Co., LTD having their registered office at 33/4 The Ninth Towers, Tower A, 32nd Floor, Rama 9 Road, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand, is Olympus's subsidiary company that is authorized to take responsibility for sales, after sales service and repair service of OLYMPUS medical endoscope products and their accessories in Thailand and Laos.



Olympus also certify that OLYMPUS (THAILAND) Co., LTD is the authorized representative and sole importer, wholesaler, after sales service and repair service of Olympus medical devices in Thailand.

This certification is being issued upon the request of the aforementioned company for whatever legal purpose it may serve them.

Sincerely yours,

Olympus Corporation

Rie Nakase
Director
Asia-Pacific Marketing



(คำแปล)

โอลิมปัส

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

หนังสือรับรองบริษัทย่อย

เรียน ท่านที่เคารพ

เราโอลิมปัส คอร์ปอเรชั่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "โอลิมปัส") ขอรับรองว่า บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 33/4 เคอะ ไนน์ ทาวเวอร์ โซนทาวเวอร์ เอ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย เป็นบริษัทย่อยของโอลิมปัสที่ได้รับอนุญาตให้รับผิดชอบด้านการขาย บริการหลังการขาย และบริการซ่อมผลิตภัณฑ์กล้องส่องทางไกลทางการแพทย์และอุปกรณ์เสริมของโอลิมปัสในประเทศไทยและลาว

โอลิมปัสขอรับรองอีกด้วยว่า บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาต และเป็นผู้นำเข้า ผู้ขายส่ง บริการหลังการขาย และบริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโอลิมปัสแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้ตามคำขอของบริษัทดังกล่าวข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายที่จะอำนวยความสะดวกแก่บริษัทเป็นอย่างดีที่สุด

ขอแสดงความนับถือ




โอลิมปัส คอร์ปอเรชั่น

-ลายมือชื่อ-

ริเอะ นาคาเสะ

กรรมการ

ฝ่ายการตลาด เอเชีย-แปซิฟิก

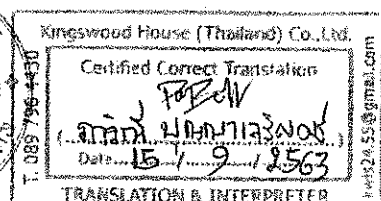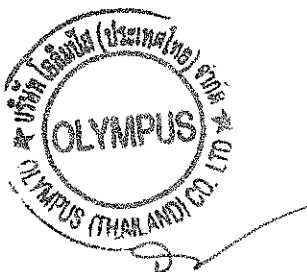



มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ศธ ๐๕๑๔.๐๔/ผบ.๔๗-๐๒๖๐๑

หนังสือสำคัญฉบับนี้รับรองว่า

นางภาริณี มุญญาเจริญศรี


รหัสประจำตัว ๕๖๐๓๐๑๘๒๐ ๒

เป็นผู้สอบไล่ได้ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ได้อนุมัติปริญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖

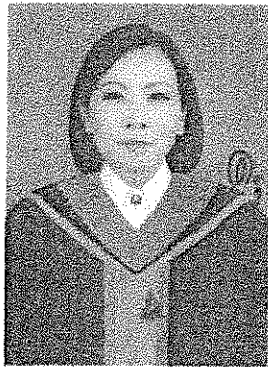

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗

วิมล วัฒน

(รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย)


ผู้อำนวยการ


สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

ภาพถ่ายของ นางภาริณี มุญญาเจริญศรี

นายมือชื่อ

เพื่อรับรองเอกสารแปล "หนังสือพิมพ์ ๕๐๐ ปีพิมพ์ไทย"
ของ บริษัท โอเคิมพีส์ จำกัด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 25๕3
เท่าที่





แบบ บ.ส.น. 1

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

ใบจดทะเบียนที่ ส.น. 88/2553

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

โดยมี นายทากะอิโร โอซาวะ เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้จดทะเบียน
 สถานประกอบการของสถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ชื่อ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 906-910

ครอบครัว/ชอย - ถนน สุขุมวิท 21

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 โทรศัพท์ 0 2260 2730-1

สถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 906-910

ครอบครัว/ชอย - ถนน สุขุมวิท 21

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 โทรศัพท์ 0 2260 2730-1

สถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 64/40

ครอบครัว/ชอย สุขุมวิท 2 ซอย 31 ถนน

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ดอกไม้ อำเภอ/เขต ประเวศ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 โทรศัพท์ 0 2727 0580

สำหรับการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ตามเอกสารแนบท้าย

โดยมีผู้ควบคุมการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6(7) ดังนี้




ใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการนี้เท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง



การต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ

การต่ออายุครั้งที่ 1

ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
(ลายมือชื่อ)
ตำแหน่ง
ผู้อนุญาต

การต่ออายุครั้งที่ 2




ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
(ลายมือชื่อ)
ตำแหน่ง
ผู้ชี้แจง

การต่ออายุครั้งที่ 3

ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
(ลายมือชื่อ)
ตำแหน่ง
ผู้อนุญาต

การต่ออายุครั้งที่ 4


ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
(ลายมือชื่อ)
ตำแหน่ง
ผู้อนุญาต

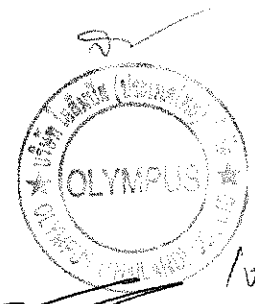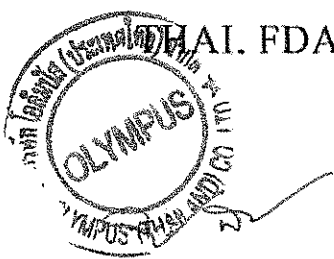

เอกสารแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ สน.88/2553

ขอรับใช้เครื่องมือแพทย์

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Anesthesiology | 2. Bariatric Services |
| 3. Cardiothoracic Surgery | 4. Emergency Medicine |
| 5. Gastroenterology | 6. Gynecology |
| 7. Healthcare Information Technology | 8. Implants |
| 9. Intensive Care Unit | 10. Internal Medicine |
| 11. Minimally Invasive Surgery | 12. Nephrology |
| 13. Obstetrics | 14. Orthopedics |
| 15. Otolaryngology | 16. Pediatrics |
| 17. Proctology | 18. Pulmonary Medicine |
| 19. Respiratory Care Services | 20. Surgery |
| 21. Urology | |


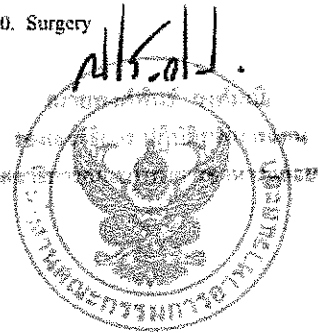


รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2556



อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนสถานประกอบการ ดังนี้

- ยกเลิกห้องเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ ห้องที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 1
 - เพิ่มสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้องเลขที่ 916 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 - เปลี่ยนผู้ดำเนินการจาก นายทากอิโร โอฮาว่า เป็น นายอากิโอะ มิโตโมะ
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป



ใบแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ สน.88/2553

หน้าที่ 1

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2557

อนุญาตให้ย้ายสถานที่นำเข้าและสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ จากเดิมเลขที่ 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 9
ห้องเลขที่ 906-910 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2260 2730
โทรสาร 0 2260 6600

เป็นเลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคารเลข ชั้น 32-33 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2000 7700 โทรสาร 0 2000 7711

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2557 เป็นต้นไป



รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2558

อนุญาตให้เพิ่มสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 114/7 ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปากรัง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2558 เป็นต้นไป






รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2559



อนุญาตให้เปลี่ยนผู้ดำเนินการจาก นายอาทิตย์ มีโคโระ เป็น นายธิดาโอะ โคบายาชิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2559 เป็นต้นไป

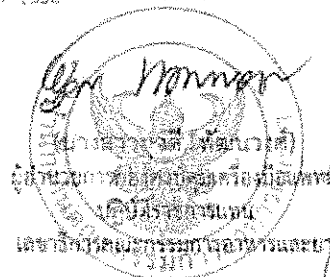

ใบอนุญาต ใบจดทะเบียนที่ ส.น. 88/2553

หน้าที่ 2

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2559

อนุญาตให้เพิ่มสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 5 ตั้งอยู่เลขที่ 567/20, 567/21 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป




รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2559

อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนสถานประกอบการ ดังนี้

1. ยกเลิกสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 2
2. เพิ่มสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 27 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250 มีจำนวน 3 ห้อง ชั้นที่ 1 จำนวน 2 ห้อง ชั้นที่ 3 จำนวน 1 ห้อง




ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป

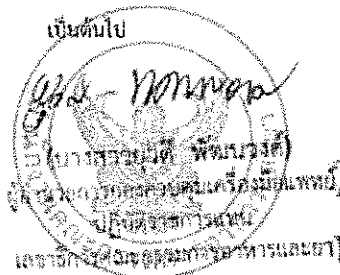

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560

อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังของสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 27 ซอยสุขาภิบาล 2
ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยเพิ่มห้องเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์บริเวณชั้นที่ 1 และ
ชั้นที่ 2 ของที่ตั้งดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป

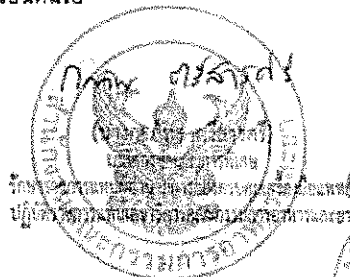

ใบแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ สน. 88/2553

หน้าที่ 3


รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560

อนุญาตให้เพิ่มสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 27 ชั้นที่ 3 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

1 มี.ค. 2561

เป็นต้นไป

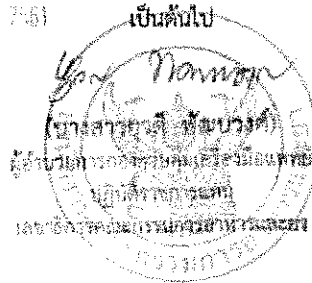

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561


อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานที่นำเข้าและสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ จากเลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์
ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น 32-33 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2000 7700
โทรสาร 0 2000 7711

เป็นเลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 โทรศัพท์ 0 2000 7700 โทรสาร 0 2000 7711

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

28 ก.ย. 2561

เป็นต้นไป

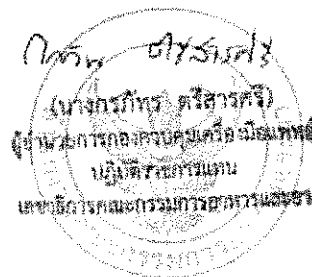



รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

อนุญาตให้เพิ่มห้องเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ในสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 27
ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 บริเวณชั้นที่ 4 จำนวน 3 ห้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

8 พ.ย. 2561

เป็นต้นไป




เอกสารแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ สน. 88/2553

หน้าที่ 4

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

อนุญาตให้ย้ายสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 5 จากเลขที่ 567/20, 567/21 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เป็นเลขที่ 456 อาคารซี ห้องเลขที่ 1-2 หมู่ที่ 23 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4300 0270



ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป

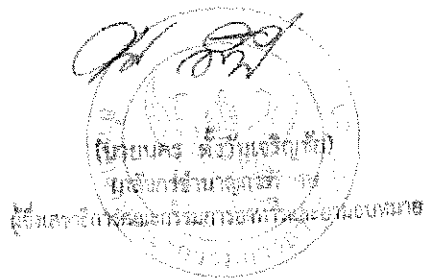

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562

อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังภายในของสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์
ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น 32 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2000 7700
โดยปรับเปลี่ยนตำแหน่งของห้องเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์และมีห้องเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์จำนวน 2 ห้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป

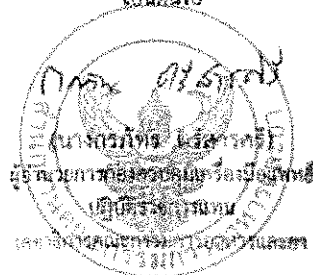

เอกสารแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ ส.น. 88/2553

หน้าที่ 5




รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ดังนี้
อนุญาตให้ยกเลิกห้องเก็บเครื่องมือแพทย์ห้องที่ 1 โดยคงเหลือห้องเก็บเครื่องมือแพทย์ ห้องที่ 2 จำนวน 1 ห้อง ในสถานที่เก็บ
รักษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 1 เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

13 ก.ย. 2562

เป็นต้นไป

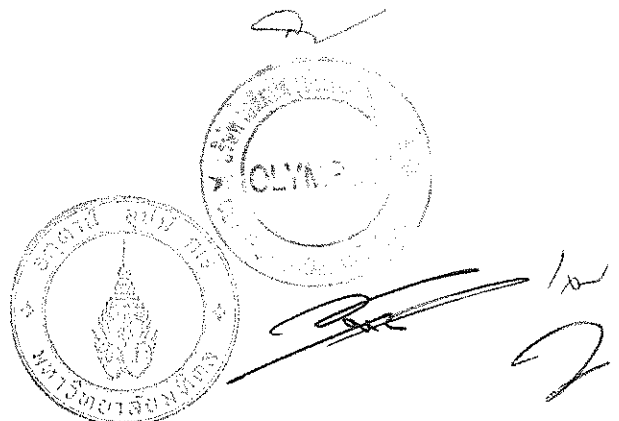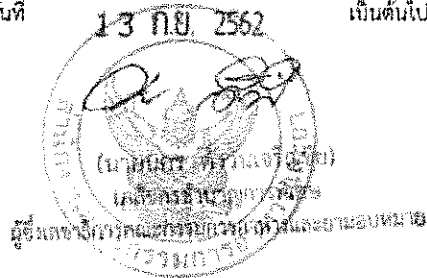

เอกสารแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ สน. 88/2553

ขอขายเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้า

รายการเครื่องมือแพทย์ในขอขายเดิม จำนวน 9 กลุ่ม ได้แก่

1. Anesthesiology

1.1 Suction Kits

UMDN Code 13846

2. Gastroenterology

2.1 Balloons, Gastric, Appetite-Suppressing

UMDN Code 17202

2.2 Colonoscopes, Video

UMDN Code 17665

2.3 Forceps, Biopsy, Flexible Endoscopic

UMDN Code 16268

2.4 Forceps, Biopsy, Rigid Endoscopic

UMDN Code 16269

2.5 Forceps, Biopsy, Other

UMDN Code 16270

2.6 Duodenoscopes

UMDN Code 11359

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ

นายวิชาโอะ โคบายาชิ



ผู้ดำเนินการ

(นายวิชาโอะ โคบายาชิ)

(นางสาวอุบลรัตน์ สกลวิฑูรย์)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

ผู้ซึ่งลงนามในใบจดทะเบียนการค้าและใบขอขาย



102


เอกสารแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ สน. 88/2553

ขอขายเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้า

2.7 Gastroscopes	UMDN Code 11856
2.8 Forceps, Grasping, Flexible Endoscopic	UMDN Code 15628
2.9 Laparoscopes, Video	UMDN Code 18087
2.10 Ureterscopes	UMDN Code 15788
2.11 Light Sources, Fiberoptic, Rigid Endoscopic/Multipurpose	UMDN Code 16831
2.12 Stents, Biliary	UMDN Code 17672
3. Gynecology	
3.1 Stents	UMDN Code 15784
4. Obstetrics	
4.1 Cannulae, Uterine	UMDN Code 10580
5. Orthopedics	
5.1 Arthroscopes	UMDN Code 10198
6. Otolaryngology	
6.1 Laryngoscopes	UMDN Code 12293
7. Pulmonary Medicine	
7.1 Bronchoscopes	UMDN Code 10491
7.2 Bronchoscopes, Flexible	UMDN Code 15073
7.3 Bronchoscopes, Flexible Video	UMDN Code 17662
8. Surgery	
8.1 Biopsy Kits	UMDN Code 10401
8.2 Cables/Leads, Electrosurgical Unit	UMDN Code 11496
8.3 Cameras, Endoscopic	UMDN Code 15748
8.4 Camera, Video, Endoscope	UMDN Code 17002

ขอรับรองว่าเป็นความจริง


ลงชื่อ  ผู้ดำเนินการ
 (นายวิชาโอะ โคบายาชิ)

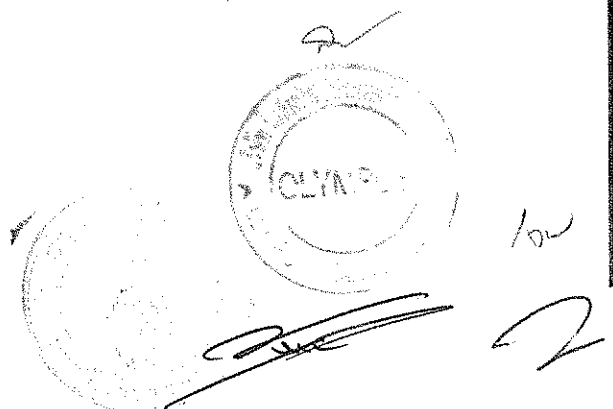

เอกสารแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ สน. 88/2553
 ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้า

8.5 Caps	UMDN Code 16081
8.6 Clamps	UMDN Code 10861
8.7 Clips, Instrument	UMDN Code 10904
8.8 Clips	UMDN Code 10898
8.9 Cystoscopes, Flexible	UMDN Code 17144
8.10 Electrodes, Electrosurgical, Active	UMDN Code 16860
8.11 Electrodes, Electrosurgical, Active, Foot-Controlled	UMDN Code 16206
8.12 Electrosurgical Unit	UMDN Code 11490
8.13 Endoscope/Camera Adapters	UMDN Code 18104
8.14 Endoscope Sheaths	UMDN Code 18424
8.15 Forceps, Biopsy	UMDN Code 11775
8.16 Forceps, Dressing	UMDN Code 11777
8.17 Forceps, Laparoscopic	UMDN Code 11779
8.18 Forceps, Electrosurgical	UMDN Code 11502
8.19 Papillotomes	UMDN Code 15625
8.20 Hooks	UMDN Code 12028
8.21 Knife Handles	UMDN Code 12235
8.22 Knife Holders	UMDN Code 12236
8.23 Knife Needles	UMDN Code 12237
8.24 Laparoscopes	UMDN Code 12291
8.25 Needle Holders	UMDN Code 12726
8.26 Probes, Fistula	UMDN Code 13121
8.27 Wire, Lesion Localization	UMDN Code 17906

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ  ผู้ดำเนินการ
 (นายอิชาโอะ โคบายาชิ)



เอกสารแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ สน. 88/2553
ขออนุญาตเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้า


8.28 Water-Jet Surgical Units	UMDN Code 20369
8.29 Water-Jet Surgical Units, Arthroscopic	UMDN Code 20370
8.30 Ultrasound Surgical Units	UMDN Code 18049
8.31 Tubing, Suction	UMDN Code 16779
8.32 Monitors, Video	UMDN Code 16603
8.33 String	UMDN Code 17585
8.34 Scissors	UMDN Code 13480
8.35 Snares	UMDN Code 13630
8.36 Surgical Instrument Container Systems	UMDN Code 16349
8.37 Television Systems, Endoscope	UMDN Code 15967
9. Urology	
9.1 Cystoscopes	UMDN Code 11112
9.2 Forceps, Stone Manipulation	UMDN Code 11793

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ  ผู้ดำเนินกิจการ
(นายชิราจาอะ โคบขาจิ)

(นางสาวอุบลรัตน์ สกลวิทย์พานิชย์)
นางสาวอุบลรัตน์ สกลวิทย์พานิชย์
ผู้ซึ่งลงนามในใบจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์

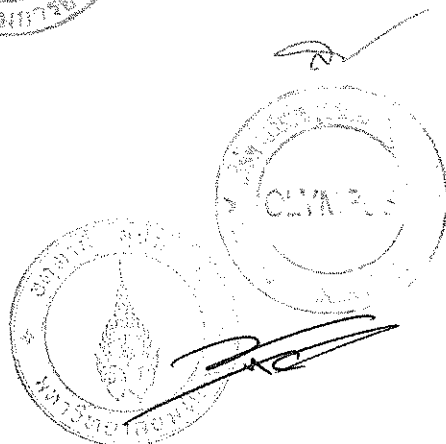

เอกสารแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ สน. 88/2553

หน้าที่ 10

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562

อนุญาตให้เพิ่มขอบข่ายและรายการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่

1. Materials Management

1.1 Adapter Cables, Pressure Transducer	UMDN Code 16969
1.2 Cleaners	UMDN Code 15013
1.3 Sterilization Containers	UMDN Code 13730
1.4 Ultrasound Cleaning Systems	UMDN Code 14263
1.5 Video Image Processors	UMDN Code 18037

2. Clinical Laboratory

2.1 Analyzers	UMDN Code 18611
2.2 Mouthpieces, Pipette Safety	UMDN Code 17824

3. Pathology

3.1. Brushes, Cytology	UMDN Code 15018
------------------------	-----------------

4. Health Facility



4.1 Valves	UMDN Code 14325
4.2 Controllers	UMDN Code 11009
4.3 Cleaners, Syringe	UMDN Code 13924

5. Nursing Services

5.1 Aspirators	UMDN Code 10208
5.2 Cannulae	UMDN Code 10561
5.3 Carts, Instrument	UMDN Code 10641
5.4 Catheters	UMDN Code 10685
5.5 Feeding Tube Patency Restorers, Flushing	UMDN Code 18593
5.6 Irrigation Kits	UMDN Code 15585
5.7 Tubes	UMDN Code 14175
5.8 Trocars	UMDN Code 14154
5.9 Trays	UMDN Code 15609
5.10 Stopcocks	UMDN Code 13803
5.11 Syringe, Plunger, Catheter, Catheter Tip, Aspiration/Irrigation	UMDN Code 20270
5.12 Syringe/Needle Adapters	UMDN Code 13922



ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา



Handwritten signature and initials.

6. Cardiology

6.1 Guide Wires

UMDN Code 11925

6.2 Suction Tips, General-purpose


UMDN Code 16883

7. Radiology

7.1. Transducers, Ultrasonic



UMDN Code 14121

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่



เป็นต้นไป

ผู้แทนการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย

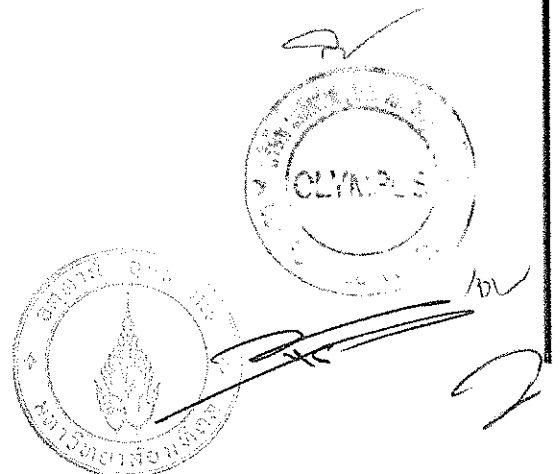

เอกสารแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ สน. 88/2553


หน้าที่ 12

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับจดทะเบียนสถานประกอบการ ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงแผนผังสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 114/7 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ครึ่ง อำเภอมือฉ่อง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 บริเวณชั้นที่ 2
2. เพิ่มห้องเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ในสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 27 ซอยสุภาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้แดง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 บริเวณชั้นที่ 2

ทำนี้ ตั้งแต่วันที่ - 31 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

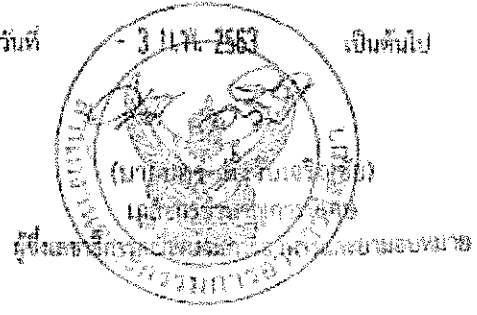


รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563



อนุญาตให้เปลี่ยนผู้ดำเนินการจาก นายอิสรารโธ ไชยยาดี เป็น นายเชอิก อามามโมโตะ

ทำนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

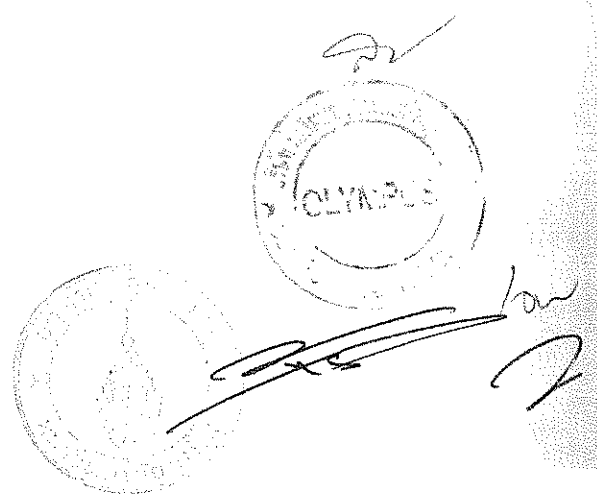



แบบ บ.น.ท 1

รับรองทั้งหมด
หนังสือรับรองประกอบกรณำเข้าเครื่องมือแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือเลขที่ JPN 6306071

23 มิถุนายน 2563

ได้พิจารณาหนังสือรับรองการขาย/หนังสือรับรองการขายและหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตแล้ว
ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531
ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อผู้ผลิต : AIZU OLYMPUS CO.,LTD.

หนังสือฉบับนี้ใช้ประกอบกับ ☒ หนังสือรับรองการขายเลขที่ 5936

ประเทศ Japan

☒ หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตเลขที่ 81 105 5776

สามารถใช้ประกอบกรณำเข้าเครื่องมือแพทย์จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2568



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข



ผู้อนุญาต

เงื่อนไข

- เมื่อปรากฏว่าประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์ห้ามขาย หรือมีการยกเลิกการรับรองระบบคุณภาพการผลิตของเครื่องมือแพทย์รายการใดตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ถือว่ากรรับรองเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
- ห้ามนำเลขที่หนังสือไปประกาศโฆษณา
- ห้ามโฆษณาว่าได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ห้ามโฆษณาเครื่องมือแพทย์ก่อนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก/เพิกถอนหนังสือรับรองประกอบกรณำเข้าเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้ หากผู้นำเข้าไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว

หมายเหตุเพิ่มเติม

ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการบันทึกเข้ามาทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

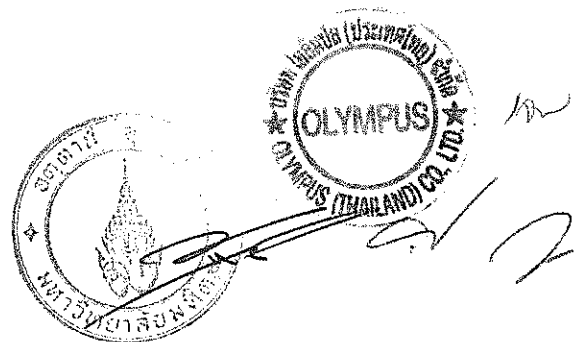



เอกสารแนบท้ายหนังสือเลขที่ JPN 6306071

เลขที่หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต

ชื่อผู้ผลิต AIZU OLYMPUS CO.,LTD.

ประเทศ Japan

ISO เลขที่ 81 105 5776

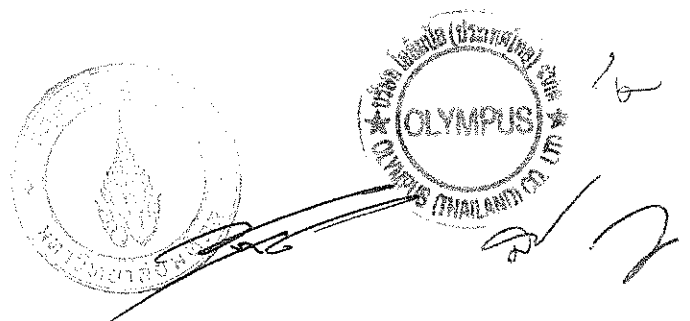

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
 รายการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ตามหนังสือรับรองเลขที่ JPN 6306071
 วันที่อนุมัติ 23/6/2563 วันที่หมดอายุ 10/3/2568

ความหมายของรหัส Owner

1 รหัส 3969 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.

ความหมายของรหัส manucl

1 รหัส 3970 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ AIZU OLYMPUS CO.,LTD.

Owner	manucl	grpno	catno	offname	pdtrname	desc	pageno	umdn	gmcln	RefItemNo
3969	3970	81 105 5776	TJF-Q190V	DUODENOVideoscope OLYMPUS		DUODENOVideoscope OLYMPUS TJF-Q190V	1	11359		6303970000026
3969	3970	81 105 5776	MA-392	MOUTHPIECE		MOUTHPIECE MA-392	1	17824		6303970000027
3969	3970	81 105 5776	MB-156	ETO CAP		ETO CAP MB-156	1	16349		6303970000028
3969	3970	81 105 5776	MH-944	CHANNEL PLUG		CHANNEL PLUG MH-944	1	16349		6303970000029
3969	3970	81 105 5776	MH-946	INJECTION TUBE		INJECTION TUBE MH-946	1	14175		6303970000030
3969	3970	81 105 5776	BW-20T	CHANNEL CLEANING BRUSH		CHANNEL CLEANING BRUSH BW-20T	1	15018		6303970000031
3969	3970	81 105 5776	MH-507	CHANNEL-OPENING CLEANING BRUSH		CHANNEL-OPENING CLEANING BRUSH MH-507	1	15018		6303970000032
3969	3970	81 105 5776	MH-856	SUCTION CLEANING ADAPTER		SUCTION CLEANING ADAPTER MH-856	1	16969		6303970000033
3969	3970	81 105 5776	MH-948	AW CHANNEL CLEANING ADAPTER		AW CHANNEL CLEANING ADAPTER MH-948	1	16969		6303970000034
3969	3970	81 105 5776	BW-412T	Single Use Combination Cleaning Brush		Single Use Combination Cleaning Brush BW-412T	1	15018		6303970000035
3969	3970	81 105 5776		Distal-end flushing adapter		Distal-end flushing adapter MAJ-2319	1	16969		6303970000036

หน้า 2
 หมายเลข 84/0000159

MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE
GOVERNMENT OF JAPAN
2-2, KASUMIGASEKI 1-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8916

CERTIFICATE

It is hereby certified that the following medical device marketed by OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP., 2-43-2 Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072 Japan is manufactured under our supervision as stipulated in the Pharmaceuticals, Medical devices and Other Therapeutic Products Act of Japan, and is certified by Certification Body to be marketed in Japan.

Medical device:

EVIS EXERA III DUODENOVideoscope OLYMPUS TIF-Q190V No. 5148 / 2563

Components:

MOUTHPIECE MA-392
ETO CAP MB-156
CHANNEL PLUG MH-944
INJECTION TUBE MH-946
CHANNEL CLEANING BRUSH BW-20T
CHANNEL-OPENING CLEANING BRUSH MH-507
SUCTION CLEANING ADAPTER MH-856
AW CHANNEL CLEANING ADAPTER MH-948
Single Use Combination Cleaning Brush BW-412T
Distal-end flushing adapter MAJ-2319

Tokyo



Name of Registered
Certification Body : TÜV Rheinland Japan Ltd.

Certification Number : 301ABBZX00014000

Date of Issue : May 24, 2019


Manufacturing Site
and Address : Aizu Olympus Co., Ltd.
500 Muranishi, Niidera, Monden-machi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima
965-8520, Japan

For legalization by the foreign consul in Japan,
this is to certify that the Seal affixed to this document
is genuine.


Tokyo, JUN 1 2020 *Tanaka Toshie*
Official
Ministry of Foreign Affairs
(Consular Service Division)

No. 5936

Tokyo, date MAR. 11. 2020

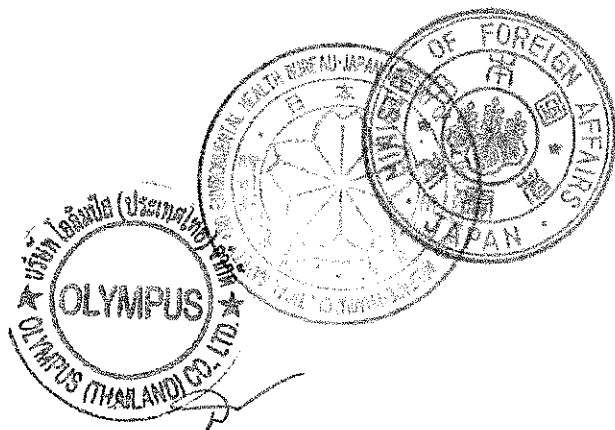

河野典
KONO Noriatsu
Director, Medical Device Evaluation Division
Pharmaceutical Safety and Environmental Health Bureau
Ministry of Health, Labour and Welfare



ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

๑. ข้าพเจ้า บริษัท โอлимпัส (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคาร เอ ชั้นที่ ๓๒ เลขที่ ๓๓/๔ ถนน พระราม ๙ แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๙๖๘๘๐๗๐๔๒ โดย นางสาวสิริกานต์ เปี่ยมสัมฤทธิ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ GJ ๓/๒๕๖๕ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว

รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่งมอบ
๑	ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีชนิดวิดีโอทัศน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	-	-	๑ ชุด	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	

(หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๓๖๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ มหาวิทยาลัย อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้อัดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ มหาวิทยาลัย ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ มหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา



๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ มหาวิทยาลัย ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕

ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ มหาวิทยาลัย ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ มหาวิทยาลัย

ขอเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า มหาวิทยาลัย ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

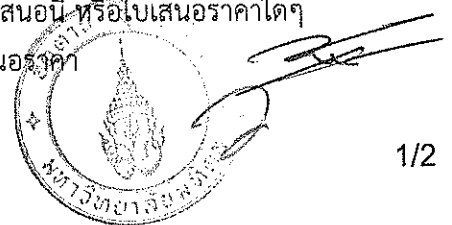

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก
แบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา
ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ มหาวิทยาลัย
ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง มหาวิทยาลัย ส่งคืนให้
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง
ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ -
เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้


๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ
ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า มหาวิทยาลัย ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด
หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล
หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด
ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๔

(นางสาวสิริกานต์
เปี่ยมสัมฤทธิ์)
ผู้แทนขาย

ใบเสนอราคาเลขที่ 6411160007227
รหัสอ้างอิง OTP NXZu
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๒๐๙๐๗๐๑

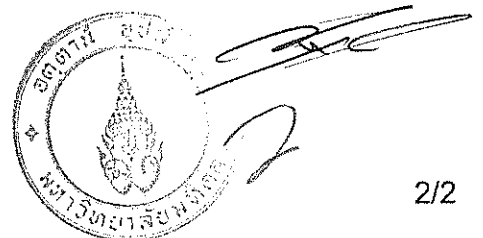

งานพิเศษ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

รับเลขที่.....0457

วันที่ 24 พ.ย. 2564

หน้า 3

หน้า 3/3

สัญญาเลขที่

8470000159

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

เรียน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ขอยืนยันราคาและชี้แจงการมอบอุปกรณ์เพิ่มเติม

อ้างถึง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีชนิดวิดีโอทัศนน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(เลขที่โครงการ : 64107334103)

เนื่องด้วยทางศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลได้สั่งซื้อ ได้มีการจัดซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีชนิดวิดีโอทัศนน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ยี่ห้อโอลิมปัส ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด นั้น บริษัทฯขอยืนยันราคาที่เสนอเป็นมูลค่า 1,880,000 (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรต่างๆแล้ว

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความยินดีมอบสินค้าเพิ่มเติมตามที่ได้มีการต่อรองราคากับคณะกรรมการเปิดซอง โดยมีรายละเอียดสินค้าดังนี้

1. แคมป์ปลายกล้องERCP จำนวน 10 กล้อง
MAJ-2315:MAJ-2315 SINGLE USE DISTAL COVER (20 pc)
2. สายต่อสำหรับลำกล้องERCPร่วมกับเครื่องล้างกล้องอัตโนมัติ จำนวน 2 เส้น
MAJ-2358:MAJ-2358 CONNECTING TUBE
3. ชุดเครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 3.1. UCR:ENDOSCOPIC CO2 REGULATION UNIT W/O CYLINDER HOSE 1 เครื่อง
 - 3.2. MAJ-1742:LOW FLOW GAS TUBE 2 ชิ้น
 - 3.3. MAJ-1816:Extra Low Flow Gas Tube 2 ชิ้น
 - 3.4. TH_CH26C:CH-26C Co2 Gas Cylinder 1.20m 1 ชิ้น
 - 3.5. TH-C42599W:C42-599 W Stainless Trolley with 1 Drawer, 35x25x80 cm for UCR, Co2 Tank, and Regulator 1 คัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ด้านระบบทางเดินอาหารและอุปกรณ์ส่องตรวจ

หัวหน้างานพิเศษ

33/4 The Ninth Towers, Tower A, 32nd Floor, Rama 9 Road, Huray Kwa, Bangkok 10310, Thailand Tel +66 2000 7700 Fax +66 2000 7711

ISO 9001 certified by Bureau Veritas Certification with UKAS and NAC accreditation.

OLYMPUS (THAILAND) CO., LTD.

ส่งเรื่องได้ทราบ ผู้รับ.....วันที่.....

ขอรับรองความถูกต้อง ผู้รับ.....วันที่.....