


บริษัท ไซวิท จำกัด
XOVIC CO., LTD.

448, 450 Soi Supharach, Phaholyothin Rd., Phayathai,
Samsaen Nai, Bangkok 10400
Tel : 02-090-2591-4
Fax : (662) 271-3737, 278-2166, 270-0513 (แฟกซ์บริการ)

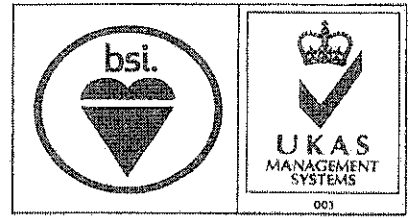

ใบเสนอราคา (Quotation)

เลขที่ AC. 4227/2567

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105529003833

เรื่อง ขอเสนอราคาอุปกรณ์ทางการแพทย์


เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ผู้แทนฝ่ายบริการ : คุณเอกสิทธิ์ ตาสึงห์ โทร. 083-924-9609

บริษัทฯ มีความยินดีเสนอราคาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ Zoll ประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-

ลำดับที่	จำนวน	รายการ	ราคา/หน่วย	ราคารวม
1	1 ชุด	8000-1010-01 : External Paddle	44,000.00	44,000.00
2	3 เส้น	8009-0750 : One Step Cable	65,340.00	196,020.00
			ลดพิเศษ 10%	24,002.00
หมายเหตุ		ราคานี้เป็นราคารวมค่าบริการแล้ว		
กำหนดยื่นราคา		90 วัน นับแต่วันเสนอราคา	ราคารวมทั้งสิ้น	216,018.00
กำหนดส่งของ		120 วัน นับแต่วันได้ลงนามในใบสั่งซื้อ	ราคาสินค้า	201,885.98
รับประกัน		90 วัน นับตั้งแต่วันส่งสินค้า	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	14,132.02
(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสิบแปดบาทถ้วน)				216,018.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ โปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

(สรโรชา ไซคอำนวย)

วิศวกร


(นายวีระชัย แสงเกื้อกูลชัย)

ผู้จัดการทั่วไป

คุณลักษณะของ
แผ่นตัวนำสัญญาณและไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ
ยี่ห้อ ZOLL รุ่น R-Series & M-Series (8000-1010-01: ESS_External Paddle)

วัตถุประสงค์การใช้งาน
เป็นชุดอะไหล่ที่ใช้สำหรับซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจ ให้พร้อมใช้งานทุก Function และมีประสิทธิภาพสูงสุด

- คุณลักษณะเฉพาะ**
1. เป็นชุดตัวนำสัญญาณและไฟฟ้าแรงดันสูง ประกอบด้วยชุดตัวนำจำนวน 2 ชุด (Apex & Sternum)
 2. มีปุ่มสำหรับควบคุมการปรับค่าพลังงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง สำหรับใช้กระตุกหัวใจของผู้ป่วยได้
 3. มีปุ่มสำหรับควบคุมการปล่อยพลังงาน สำหรับใช้กระตุกหัวใจของผู้ป่วยได้
 4. สามารถใช้งานได้ทั้ง เด็กโตและผู้ใหญ่ (Pediatric & Adult)
 5. เป็นชุดอะไหล่ที่ใช้งานร่วมกับเครื่องกระตุกหัวใจยี่ห้อ ZOLL รุ่น M-Series และ R-Series เท่านั้น

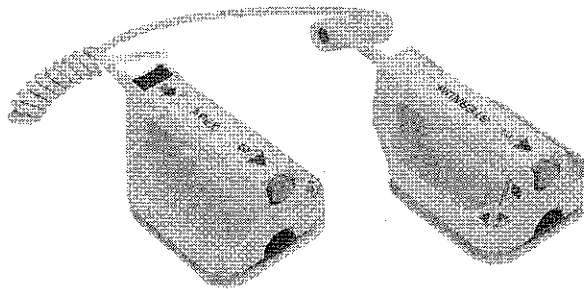

สำเนาถูกต้อง
/ (สโรชา โชคอำนวย)
วิศวกร

สายต่อจากเครื่องกระตุ้นหัวใจรองรับการกดหน้าอกด้วยแผ่นกระตุ้นหัวใจพิเศษ
หมวดควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
8009-0750


OneStep™ Pacing Cable, 100-240V 50Hz, (Supports Real CPR Help and OneStep™ Pacing)

คุณสมบัติทั่วไป


เป็นต่อจากเครื่องกระตุ้นหัวใจ เพื่อต่อไปยังแผ่นกระตุ้นหัวใจ หรือใช้ร่วมกับเครื่องกระตุ้นหัวใจ R Series

ลักษณะผลิตภัณฑ์

1. สามารถใช้ซ้ำได้โดยทำความสะอาดหลังใช้งาน
2. บรรจุใน package บรรจุภัณฑ์แบบกล่อง แต่สามารถเปิดออกได้โดยง่าย
กล่องบรรจุมองเห็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดชัดเจน
3. สามารถใช้งานกับเครื่องกระตุ้นหัวใจรุ่น R Series

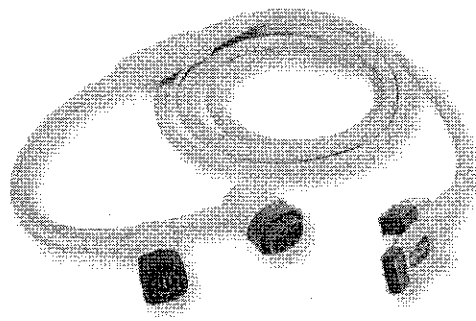


สำเนาถูกต้อง
✓
(สโรชา โชคอำนวย)
วิศวกร



บริษัท โซวิต จำกัด
XOVIC CO., LTD.

448, 450 Soi Supharach, Phaholyothin Rd., Phayathai,
Samsaen Nai, Bangkok 10400
Tel : 02-090-2591-4
Fax : (662) 271-3737, 278-2166, 270-0513 (แผนกบริการ)



ใบเสนอราคา (Quotation)

เลขที่ AC. 0262/2568

วันที่ 21 มกราคม 2568

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105529003833

เรื่อง ขอสันอราคาอุปกรณ์ทางการแพทย์
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ผู้แทนฝ่ายบริการ : คุณเอกสิทธิ์ คาสังห์ โทร. 083-924-9609

บริษัทฯ มีความยินดีเสนอราคาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ Zoll ประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-

ลำดับที่	จำนวน	รายการ	ราคา/หน่วย	ราคารวม
1	3 ก้อน	8019-0535-01 : Sure Power Rechargeable Lithium Ion Battery Pack for R Series SN : AF17H069117 63 00295 SN : AF17H069151 63 00293 SN : AF17H069128 63 00294	32,000.00 ลดพิเศษ 10%	96,000.00 9,600.00
หมายเหตุ		ราคานี้เป็นราคารวมค่าบริการแล้ว		
กำหนดยื่นราคา	90 วัน นับแต่วันเสนอราคา		ราคารวมทั้งสิ้น	86,400.00
กำหนดส่งของ	120 วัน นับแต่วันได้ลงนามในใบสั่งซื้อ		ราคาสินค้า	80,747.66
รับประกัน	90 วัน นับตั้งแต่วันส่งสินค้า		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	5,652.34
(แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				86,400.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ


(นายวีระชัย แสงเกื้อกุลชัย)

ผู้จัดการทั่วไป



บริษัท โขวิท จำกัด
XOVIC CO., LTD.

448, 450 Phaholyothin Rd., Phayathai, Bangkok 10400
Tel : 02-616-8160-2, 278-2166, 278-4157, 278-0194
Fax : (662) 271-3737, 278-2166, 270-0513 (แผนกบริการ)

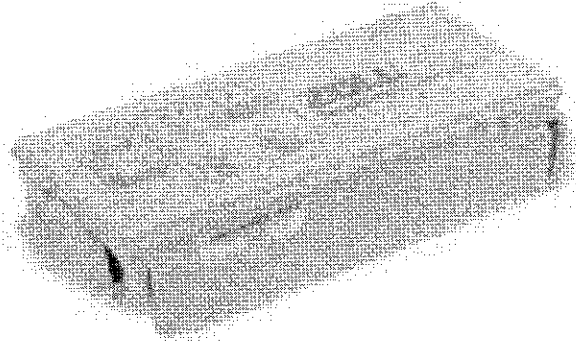

Sure Power Rechargeable Lithium Ion Battery Pack


(แบตเตอรี่สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า)

วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่อง Defibrillator Zoll รุ่น R Series ที่มีอยู่ภายในโรงพยาบาล

คุณสมบัติทั่วไป

1. สามารถใช้ร่วมกับเครื่อง Defibrillator Zoll รุ่น R Series
2. เป็นประเภท Battery Lithium Ion
3. เป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน
4. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 3 เดือน
5. ในช่วงรับประกันถ้าเครื่องเสียในอุปกรณ์ดังกล่าวทางบริษัทจะนำอะไหล่ใหม่มาเปลี่ยนให้ทันที
6. บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียว



10/10/63 10/10/63

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อรายการ จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟล็คพร้อมกระตุ้นจังหวะ

จำนวน 3 หน่วยนับ งาน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ความต้องการ

จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟล็คพร้อมกระตุ้นจังหวะ จำนวน 3 งาน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	รหัสครุภัณฑ์
1	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟล็คพร้อมกระตุ้นจังหวะ	831000001755
2	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟล็คพร้อมกระตุ้นจังหวะ	831000001756
3	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟล็คพร้อมกระตุ้นจังหวะ	831000001754

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีดังนี้

ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

3. คุณลักษณะทั่วไป

จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟล็คพร้อมกระตุ้นจังหวะ จำนวน 3 งาน

โดยการเปลี่ยนอะไหล่

4. คุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับ	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	รายการซ่อม
1	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟลลิก พร้อมกระตุ้นจังหวะ	831000001755	-External Paddle จำนวน 1 ชุด -One Step Cable จำนวน 1 เส้น -Battery จำนวน 1 ก้อน
2	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟลลิก พร้อมกระตุ้นจังหวะ	831000001756	-One Step Cable จำนวน 1 เส้น -Battery จำนวน 1 ก้อน
3	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟลลิก พร้อมกระตุ้นจังหวะ	831000001754	-One Step Cable จำนวน 1 เส้น -Battery จำนวน 1 ก้อน

5. เงื่อนไขเฉพาะ (ถ้ามี)

-กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน

-กำหนดรับประกัน 90 วัน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



(นางสาวสโรชา โชคอำนวย)

ตำแหน่ง วิศวกร

ใบสั่งจ้าง

ติดต่อการแสดงปฎิบัติตามประมวลรัษฎากร

รหัสใบสั่งจ้าง : 3080006542/2568 - ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ถึง บริษัท โซวิค จำกัด

วันที่ 11 เมษายน 2568

ตามที่ท่านได้เสนอรับจ้างทำการ ซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟลิกพร้อมกระตุ้นจังหวะ จำนวน 3 งาน
ตามใบเสนอราคาเลขที่ - ของท่าน ลงวันที่ 21.01.2025 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาแล้วตกลงจ้างท่านให้ทำการซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟลิกพร้อมกระตุ้นจังหวะ
จำนวน 3 งาน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม
ให้ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบท้ายใบสั่งจ้างนี้ทุกประการโดยท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1	จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟลิกพร้อมกระตุ้นจังหวะ รหัสครุภัณฑ์ 831000001755 โดยมีรายละเอียดดังนี้ -External Paddle จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 39,600.- บาท -One Step Cable จำนวน 1 เส้น เป็นเงิน 58,806.- บาท -Battery Pack for R Series จำนวน 1 ก้อน เป็นเงิน 28,800.- บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 127,206.- บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ AC.4227/2567, AC.0262/2568 ลงวันที่ 21 มกราคม 2568	1.00 งาน	127,206	00	127,206	00
2	จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟลิกพร้อมกระตุ้นจังหวะ รหัสครุภัณฑ์ 831000001756 โดยมีรายละเอียดดังนี้ -One Step Cable จำนวน 1 เส้น เป็นเงิน 58,806.- บาท -Battery จำนวน 1 ก้อน เป็นเงิน 28,800.- บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 87,606.- บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ AC.4227/2567, AC.0262/2568 ลงวันที่ 21 มกราคม 2568	1.00 งาน	87,606	00	87,606	00
3	จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟลิกพร้อมกระตุ้นจังหวะ รหัสครุภัณฑ์ 831000001754	1.00 งาน	87,606	00	87,606	00

โดยมีรายละเอียดดังนี้ -One Step Cable จำนวน 1 เส้น เป็นเงิน 58,806.- บาท -Battery จำนวน 1 ก้อน เป็นเงิน 28,800.- บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 87,606.- บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ AC.4227/2567, AC.0262/2568 ลงวันที่ 21 มกราคม 2568					
ตามแผนสองพันสี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน		จำนวนเงินรวม	302,418	00	

1. ในการปฏิบัติตามใบสั่งจ้างนี้ ท่านจะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดี ใช้เครื่องมือดีและช่างฝีมือดี เพื่อประกอบการทำงานนี้จนแล้วเสร็จ
2. งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะยอมรับ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตรวจรับไว้เป็นการครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างแล้ว
3. ในวันส่งมอบงานจ้าง ท่านจะต้องนำใบสั่งจ้างพร้อมหลักฐานการส่งงานมามอบให้ไว้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
4. ท่านจะต้องส่งมอบงานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ภายในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2568
เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดลปรับเป็นรายวัน วันละ 303.- บาท
นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ
งานตามใบสั่งจ้างนี้เป็นวันเริ่มต้นจนถึงวันที่ท่านได้ส่งมอบงานจ้างให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลจนครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง
ทุกประการ
5. เมื่องานเสร็จเรียบร้อยและมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบงานจากท่านแล้ว ถ้ามีเหตุชำรุดเสียหายเกิดแก่งานจ้างนี้ ภายใน - ปี - เดือน และ 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบงานโดยให้นับวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเหตุชำรุดเสียหายนั้น
เกิดจากความบกพร่อง ของท่านจะเป็น โดยทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือใช้ของที่ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาก็ตาม
ท่านจะต้องรับทำการแก้ไขซ่อมแซม ให้เป็นที่เรียบร้อยภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น โดยไม่คิด เอาค่าสิ่งของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากมหาวิทยาลัยมหิดลอีก
6. ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวไปยังผู้ขายหรือผู้รับจ้าง โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่อยู่ปรากฏ ไว้ใน ใบเสนอราคา/ตามสัญญา ถือว่าการแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวได้ส่งถึงผู้ขายโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ถ้างานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้น หลังจากระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ท่านยังต้องรับผิดชอบที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย

๒

(ลงชื่อ) ผู้สั่งจ้าง
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างฉบับนี้ไปและได้อ่านเข้าใจข้อความในใบสั่งจ้างนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติ
ตามข้อความในใบสั่งจ้างทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้รับใบสั่งจ้าง

(.....)

(ตำแหน่ง)

(ประทับตรา/บริษัท/ห้างฯ/ร้าน)

วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ อว ๗๘.๐๗๓๕/พด ๐๖๐๓๓

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟล็คพร้อมกระตุ้นจังหวะ จำนวน ๓ งาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟล็คพร้อมกระตุ้นจังหวะ จำนวน ๓ งาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
๑. จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟล็คพร้อมกระตุ้นจังหวะ จำนวน ๑ งาน	บริษัท โซวิค จำกัด	๑๒๗,๒๐๖.๐๐	๑๒๗,๒๐๖.๐๐
๒. จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟล็คพร้อมกระตุ้นจังหวะ จำนวน ๑ งาน	บริษัท โซวิค จำกัด	๘๗,๖๐๖.๐๐	๘๗,๖๐๖.๐๐
๓. จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟล็คพร้อมกระตุ้นจังหวะ จำนวน ๑ งาน	บริษัท โซวิค จำกัด	๘๗,๖๐๖.๐๐	๘๗,๖๐๖.๐๐
รวม			๓๐๒,๔๑๘.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

๐๔๖๘
๖
24 เม.ย. 2568


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติ ให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
๒. ลงนาม ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่เสนอมาพร้อมนี้
๓. ลงนาม ในใบสั่งจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ ตามที่เสนอมาพร้อมนี้


(นางศันสนีย์ โชคนาคะวโร)


นักวิชาการพัสดุ

10 เม.ย. 2568



(นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)

หัวหน้างานพัสดุ

10 เม.ย. 2568


(แพทย์หญิงศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล)

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 23 เม.ย. 2568



(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กฤตดาเรืองไกร)
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟลสิกพร้อมกระตุ้นจังหวะ จำนวน ๓ งาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี
โครงการ จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟลสิกพร้อมกระตุ้นจังหวะ จำนวน ๓ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟลสิกพร้อมกระตุ้นจังหวะ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บริษัท โซวิค จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๒๐๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
เจ็ดพันสองร้อยหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟลสิกพร้อมกระตุ้นจังหวะ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บริษัท โซวิค จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๖๐๖.๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันหก
ร้อยหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟลสิกพร้อมกระตุ้นจังหวะ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บริษัท โซวิค จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๖๐๖.๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันหก
ร้อยหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๐

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ใบปะหน้าส่งแฟกซ์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

888 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158378

ผู้ส่ง : นางศันสนีย์ ไชยนาคะวโร

ติดต่อ : ณ อาคารกาญจนาภิเษก งานพัสดุ ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ : 02-8496600 ต่อ 6383 / มือถือ : 097-1186999

เบอร์ FAX : 02-8496600 ต่อ 1100

E-mail: jeabkittys21@hotmail.com

(หากบริษัทได้รับแฟกซ์แล้วกรุณาส่งกลับหรือโทรแจ้ง เพื่อยืนยันการรับเอกสาร)

หมายเหตุ : * หากมียอดการสั่งจ้าง ตั้งแต่ 30,000.- บาท ขึ้นไป กรุณาเซ็นต์ตอบ
รับใบสั่ง และ แฟกซ์กลับ พร้อมนำเอกสารแนบมาด้วย อัตราอากรแสตมป์ 1000
ละ 1 บาท

*หากมียอดการสั่งจ้าง / สั่งซื้อ ตั้งแต่ 200,000.- บาท ขึ้นไป กรุณา
เข้ามารับเอกสารต้นฉบับไป ทำการสลักหลัง ณ ที่สรรพากรอำเภอพุทธมณฑล
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ใบสั่ง ***หากเกิน 15 วัน จะต้องเสียเบี้ยปรับ***

* กรณีทำสัญญา* กรุณา Fax เอกสารหนังสือคำประกันสัญญาก่อน
เข้ามาทำสัญญา เพื่อที่จะได้กรอกสัญญาเตรียมไว้ให้บริษัทเข้ามาทำสัญญา (หาก
เป็นไปได้ขอเป็นหนังสือคำประกัน เพื่อความสะดวกในการทำสัญญา)

***** ขอขอบคุณ ที่ให้ความร่วมมือทุกท่านค่ะ *****