

GETINGE *

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 888 หมู่ที่ 6
ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

ใบเสนอราคา / Quotation
8091030973

11 เม.ย. 2568

ลูกค้า	2013073
บริการ	Anusit Potisat
โทรศัพท์	0655241058
ผู้จัดทำเอกสาร	Pinichai Chumpa
โทรศัพท์	0655241068
แฟกซ์	02-704 4024

เรื่อง เสนอราคาอะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องนั่งมาเชื้อ ยี่ห้อ Getinge
รุ่น HS 6613 ER-2 LTSF S/N:0011131805-010-02 (No.4)

เรียน ผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาอะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องนั่งมาเชื้อ
ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นสาขาของผู้ผลิต Getinge ประจำประเทศไทย
รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย บาท	ราคารวม บาท
1	HEATEXCHANGER CB 30-26H P/N:6015964001	1 ตัว	56,496 66,000.00	52,800 66,000.00
2	SOLENOID VALVE 3-way P/N:6014000001	1 ตัว	16,264 19,000.00	15,200 19,000.00
	รวมเงิน			85,000.00
	ส่วนลด (Discount)	20.00-%		17,000.00-
	ยอดเงินคงเหลือ			68,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %		4,760.00
	ยอดเงินสุทธิ			72,760.00

เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน

ยื่นราคา 90 วัน
เงื่อนไข ชำระเงิน 90 วัน นับจาก วันที่ ใบแจ้งหนี้
กำหนดส่งของ 90 วันหลังจากได้รับใบสั่งจ้าง
รับประกันสินค้า 180 วัน
หมายเหตุ: รวมค่าบริการติดตั้ง

สำเนาถูกต้อง

(สโรชา โชคอำนวย)

วิศวกร


GETINGE (Thailand) Co.,Ltd.
5 Soi Krungthepkreetha 4 (B.GRIMM) Huamark
Bangkapi, Bangkok 10240
Telephone: (+66) 02-704-4388
Fax no.: (+66) 02-704-4024
www.getinge.com



บริษัท เกทิงเง (ไทยแลนด์) จำกัด
ขอแสดงความนับถือ

B. Kuek

(นายบัณฑิต คัมภีร์)
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการ

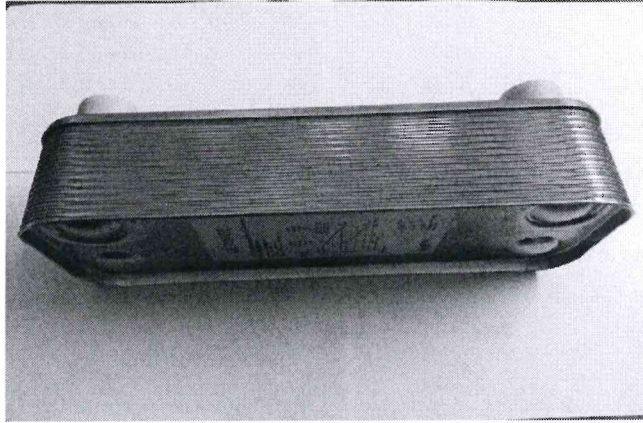

รายละเอียดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
(HEAT EXCHANGER)

ชื่อพัสดุ

ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
HEAT EXCHANGER

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นอะไหล่ประกอบใช้งานกับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
ยี่ห้อ "GETINGE"

รายละเอียด


- เป็นอะไหล่ประกอบใช้งานกับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ "GETINGE"
- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อทำการควบแน่นไอน้ำภายในห้องนึ่งให้กลายเป็นน้ำ ก่อนที่จะทำการปล่อยทิ้งไปยังท่อน้ำทิ้ง
- ทำจากสแตนเลสสตีลและทองแดง

สำเนาถูกต้อง

ส

(สโรชา โชคอำนวย)

วิศวกร

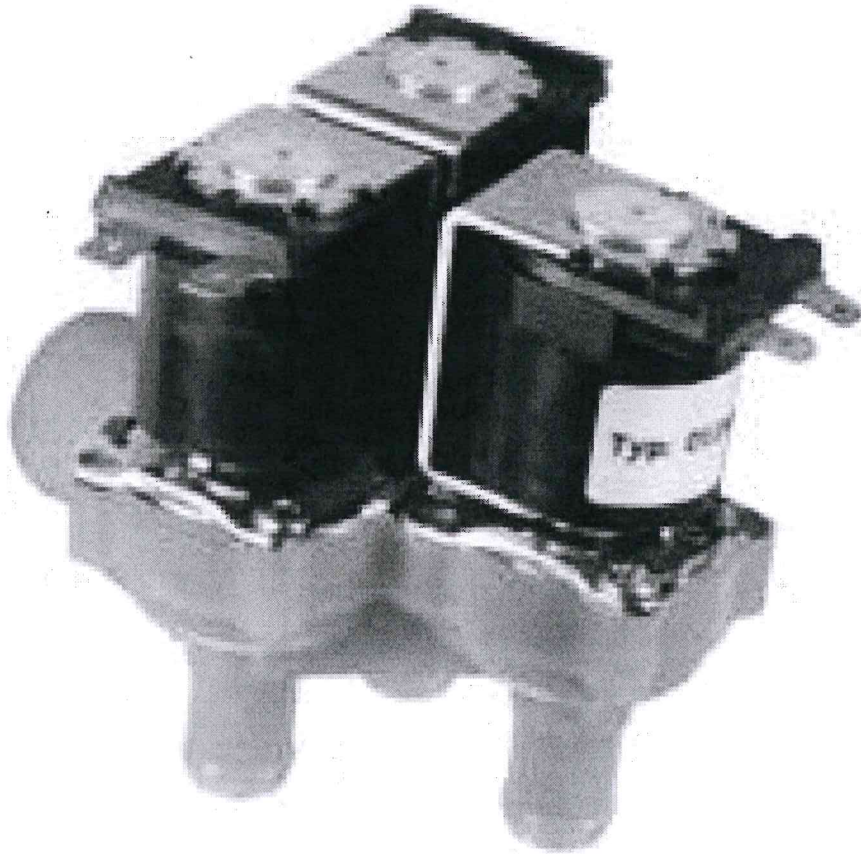

ชื่อพัสดุ

SOLENOID VALVE 3 way

No. 6014000001

รายละเอียด

- SOLENOID VALVE 3 way ใช้กับเครื่องนึ่งยี่ห้อ “GETINGE”
- ชิ้นส่วนมีส่วนประกอบของพลาสติกและคอยล์ขดลวดทองแดง
- ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำหล่อเย็นที่เข้าไปภายในเครื่องนึ่ง

เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 180 วัน นับจากวันส่งมอบ

๔.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

สำเนาถูกต้อง

(สโรชา โชคอำนวย)

วิศวกร

GETINGE *

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 888 หมู่ที่ 6
ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

ใบเสนอราคา / Quotation

8091030974

1.1 วันที่ 2568

ลูกค้า	2013073
บริการ	Anusit Potisat
โทรศัพท์	0655241058
ผู้จัดทำเอกสาร	Pinichai Chumpa
โทรศัพท์	0655241068
แฟกซ์	02-704 4024

เรื่อง เสนอราคาอะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องล้างฆ่าเชื้อ
Cart Washer รุ่น 9120 S/N:WAA089852

เรียน ผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาอะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องล้างฆ่าเชื้อ
ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นสาขาของผู้ผลิต Getinge ประจำประเทศไทย
รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย บาท	ราคารวม บาท
1	SOLENOID VALVE, ASSY 9100E P/N:6001760501	1 ชุด	153,900.00	153,900.00
	รวมเงิน			153,900.00
	ส่วนลด (Discount)	20.00-%		30,780.00-
	ยอดเงินคงเหลือ			123,120.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %		8,618.40
	ยอดเงินสุทธิ			131,738.40

หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์

ขึ้นราคา 90 วัน
เงื่อนไข ชำระเงิน 90 วัน นับจาก วันที่ ใบแจ้งหนี้
กำหนดส่งของ 90 วันหลังจากได้รับใบสั่งจ้าง
รับประกันสินค้า 180 วัน
หมายเหตุ: รวมค่าบริการติดตั้ง

สำเนาถูกต้อง

(สโรชา โชคอำนวย)

วิศวกร


GETINGE (Thailand) Co.,Ltd.
5 Soi Krungthepkreetha 4 (B.GRIMM) Huamark
Bangkapi, Bangkok 10240
Telephone: (+66) 02-704-4388
Fax no.: (+66) 02-704-4024
www.getinge.com



บริษัท เกทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด
ขอแสดงความนับถือ

B. Kuek
(นายบัณฑิต คัมภีร์)

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการ

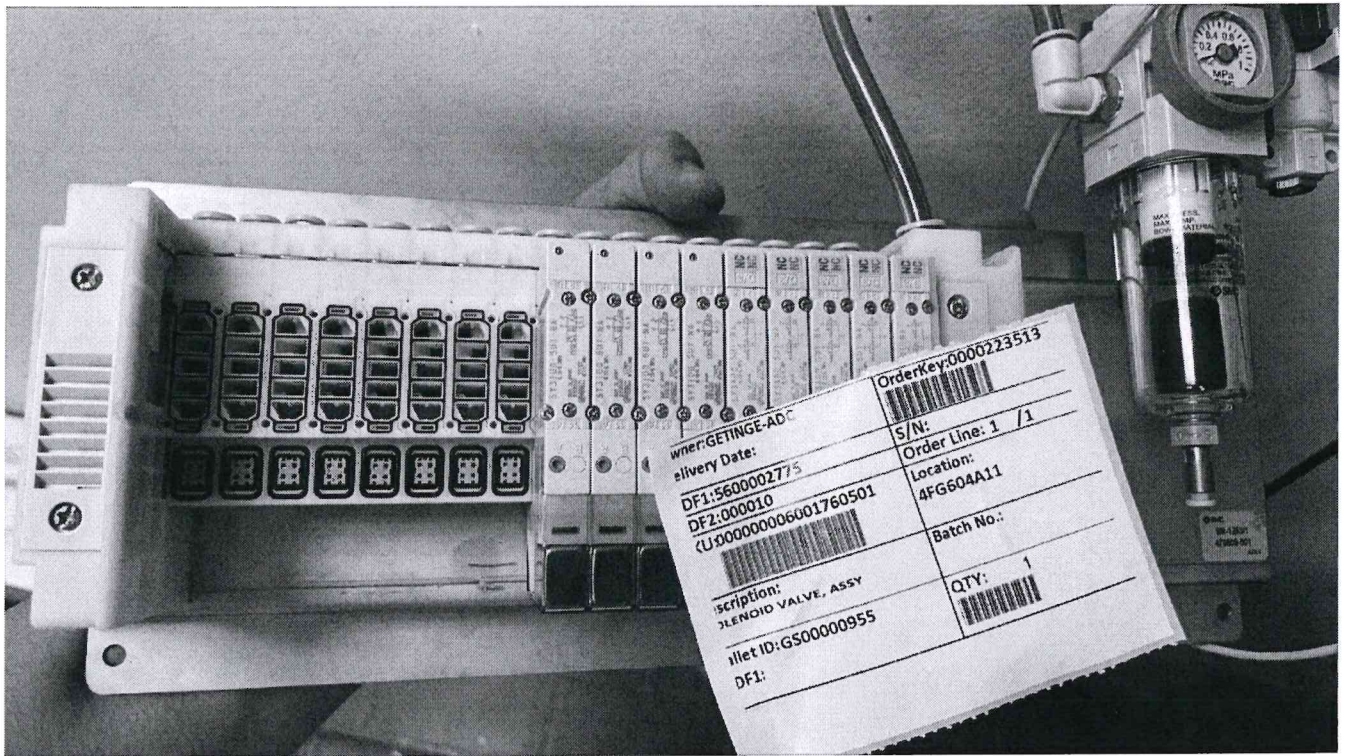

SOLENOID VALVE, ASSY

ชื่อพัสดุ

No. 6001760501

รายละเอียด

- ชุด Solenoid Valve ใช้ควบคุมวาล์วต่างๆของเครื่องล้างยี่ห้อ “GETINGE”
- ชิ้นส่วนผลิตจากโลหะอลูมิเนียมและมีส่วนประกอบบางอย่างเป็นยางและพลาสติก
- ประกอบด้วยชุดปรับแรงดันลมฐานยึดและชุด Solenoid

เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 180 วัน นับจากวันส่งมอบ

๔.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

สำเนาถูกต้อง

✓

(สโรชา โชคอำนวย)

วิศวกร

GETINGE *

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 888 หมู่ที่ 6
ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

ใบเสนอราคา / Quotation
8091031296

11 เม.ย. 2568

ลูกค้า	2013073
บริการ	Anusit Potisat
โทรศัพท์	0655241058
ผู้จัดทำเอกสาร	Pinichai Chumpa
โทรศัพท์	0655241068
แฟกซ์	02-704 4024

เรื่อง เสนอราคาอะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องล้างฆ่าเชื้อ
รุ่น 46-4 S/N:SEV0726069 (No.1)

เรียน ผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาอะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องล้างฆ่าเชื้อ
ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นสาขาของผู้ผลิต Getinge ประจำประเทศไทย
รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย บาท	ราคาสุทธิ บาท
1	FILTER DRYER 46-4/5 P/N:503840300	1 ตัว	30,500.00 26,108	30,500.00
2	HOSE RUBBER WITH CHECK VALVE P/N:501251075	1 ตัว	17,350.00 14,851.60	17,350.00
	รวมเงิน			47,850.00
	ส่วนลด (Discount)	20.00-%		9,570.00-
	ยอดเงินคงเหลือ			38,280.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %		2,679.60
	ยอดเงินสุทธิ			40,959.60

สี่หมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์


ยื่นราคา 90 วัน
เงื่อนไข ชำระเงิน 90 วัน นับจาก วันที่ ใบแจ้งหนี้
กำหนดส่งของ 90 วันหลังจากได้รับใบสั่งจ้าง
รับประกันสินค้า 180 วัน
หมายเหตุ: รวมค่าบริการติดตั้ง

สำเนาถูกต้อง
/ (สโรชา โชคอำนวย)
วิศวกร



บริษัท เกทท์อิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด
ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต คัมภีร์)
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการ

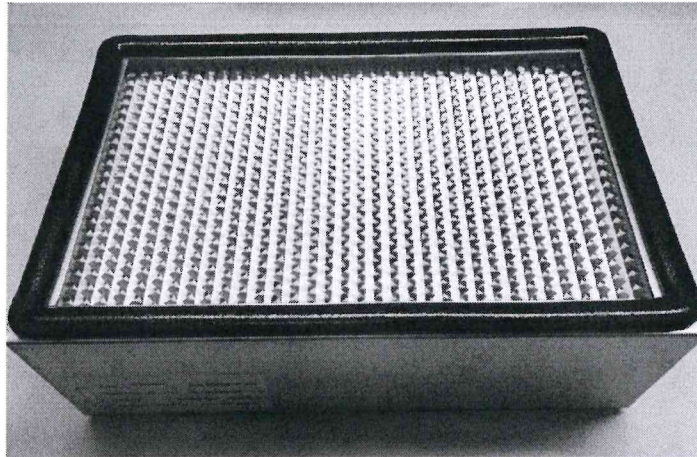

ชื่อพัสดุ

FILTER DRYER 46-4/5

503840300

รายละเอียด

- ใช้สำหรับกรองอากาศก่อนเข้าเครื่องล้างยี่ห้อ “GETINGE”
- ชิ้นส่วนผลิตจากอลูมิเนียมและชุดกรองอากาศ
- ใช้สำหรับกรองฝุ่นที่มีความขนาดเล็ก

เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 180 วัน นับจากวันส่งมอบ

๔.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

สำเนาถูกต้อง

ส
(สโรชา โชคอำนวย)
วิศวกร



ชื่อพัสดุ

HOSE RUBBER WITH CHECK VALVE

No. 501251075

รายละเอียด

- ท่อน้ำทิ้งที่ต่อกับปั๊มDainของเครื่องล้างรุ่น46ยี่ห้อ “GETINGE”
- ชิ้นส่วนผลิตจากยางทนความร้อนและมีชุดกันน้ำไหลย้อนกลับอยู่ด้านใน
- ประกอบด้วยท่อยางทนความร้อนเช็ควาวพลาสติกและเข็มขัดรัดเช็ควาว

เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 180 วัน นับจากวันส่งมอบ

๔.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

สำเนาถูกต้อง

ส
(สโรชา โชคอำนวย)
วิศวกร

GETINGE *

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 888 หมู่ที่ 6
ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

ใบเสนอราคา / Quotation
8091031299

11 เม.ย. 2568

ลูกค้า	2013073
บริการ	Anusit Potisat
โทรศัพท์	0655241058
ผู้จัดทำเอกสาร	Pinichai Chumpa
โทรศัพท์	0655241068
แฟกซ์	02-704 4024

เรื่อง เสนอราคาอะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ Getinge
รุ่น HS 6613 AR-2 S/N:2503446-010-01 (No.1)

เรียน ผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาอะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ
ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นสาขาของผู้ผลิต Getinge ประจำประเทศไทย
รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย บาท	ราคารวม บาท
1	SWITCH PRESSURE -1 - +1 BAR P/N:469517302	1 ตัว	40,300.00	40,300.00
	รวมเงิน			40,300.00
	ส่วนลด (Discount)	20.00-%		8,060.00-
	ยอดเงินคงเหลือ			32,240.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %		2,256.80
	ยอดเงินสุทธิ			34,496.80

สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์

ยื่นราคา 90 วัน
เงื่อนไข ชำระเงิน 90 วัน นับจาก วันที่ ใบแจ้งหนี้
กำหนดส่งของ 90 วันหลังจากได้รับใบสั่งจ้าง
รับประกันสินค้า 180 วัน
หมายเหตุ: รวมค่าบริการติดตั้ง

สำเนาถูกต้อง

สโรชา โชคอำนวย


วิศวกร

บริษัท เกทิงเงอ (ไทยแลนด์) จำกัด
ขอแสดงความนับถือ

GETINGE (Thailand) Co.,Ltd.
5 Soi Krungthepkreetha 4 (B.GRIMM) Huamark
Bangkapi, Bangkok 10240
Telephone: (+66) 02-704-4388
Fax no.: (+66) 02-704-4024
www.getinge.com



(นายบัณฑิต คัมภีร์)
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการ

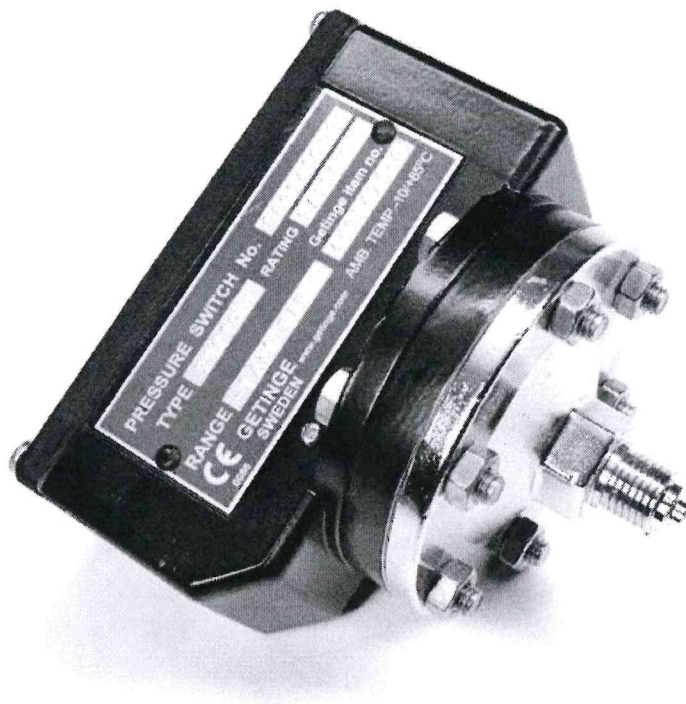

ชื่อพัสดุ SWITCH PRESSURE 207 CEQ-1, -1
469517302

รายละเอียด

- ใช้สำหรับตรวจวัดแรงดันไอน้ำในห้องนึ่งของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อยี่ห้อ “GETINGE”
- ชิ้นส่วนผลิตจากอลูมิเนียมอะลูมิเนียมและแผ่นทองแดง
- มีไมโครสวิตช์เป็นตัวส่งสัญญาณภายใน

เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 180 วัน นับจากวันส่งมอบ

๔.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

สำเนาถูกต้อง
ส
(ศโรชา โชคอำนวย)
วิศวกร

GETINGE *

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 888 หมู่ที่ 6
ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

ใบเสนอราคา / Quotation 8091031535

ลูกค้า	2013073
บริการ	Anusit Potisat
โทรศัพท์	0655241058
ผู้จัดทำเอกสาร	Pinichai Chumpa
โทรศัพท์	0655241068
แฟกซ์	02-704 4024

เรื่อง เสนอราคาอะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ Getinge
รุ่น HS 6613 ER-2 S/N:2112671-010-01 (No.3)

เรียน ผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาอะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ
ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นสาขาของผู้ผลิต Getinge ประจำประเทศไทย
รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย บาท	ราคาสุทธิ บาท
1	HEAT EXCHANGER CB14-10H P/N:561026601	1 ตัว	32,004.40	37,400.00
2	PISTON VALVE 1" SS OUT THREAD P/N:570110102	1 ตัว	38,348.80	44,800.00
	รวมเงิน			82,200.00
	ส่วนลด (Discount)	20.00-%		16,440.00-
	ยอดเงินคงเหลือ			65,760.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %		4,603.20
	ยอดเงินสุทธิ			70,363.20

เจ็ดหมื่นสามร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบสตางค์

ขึ้นราคา 90 วัน
เงื่อนไขชำระเงิน 90 วัน นับจาก วันที่ ใบแจ้งหนี้
กำหนดส่งของ 90 วันหลังจากได้รับใบสั่งจ้าง
รับประกันสินค้า 180 วัน
หมายเหตุ: รวมค่าบริการติดตั้ง

สำเนาถูกต้อง
✓
(สโรชา โชคอำนวย)
วิศวกร

GETINGE (Thailand) Co.,Ltd.
5 Soi Krungthepkreetha 4 (B.GRIMM) Huamark
Bangkapi, Bangkok 10240
Telephone: (+66) 02-704-4388
Fax no.: (+66) 02-704-4024
www.getinge.com



บริษัท เกทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด
ขอแสดงความนับถือ

(นายปณิชา ชุ่มภู่)
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการ



รายละเอียดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
(HEAT EXCHANGER)

ชื่อพัสดุ

ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
HEAT EXCHANGER

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นอะไหล่ประกอบใช้งานกับเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ “GETINGE”

รายละเอียด


- เป็นอะไหล่ประกอบใช้งานกับเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ “GETINGE”
- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนความร้อน เพื่อทำการควบแน่นไอน้ำภายในห้องนั่งให้กลายเป็นน้ำ ก่อนที่จะทำการปล่อยทิ้งไปยังท่อน้ำทิ้ง
- ทำจากสแตนเลสสตีล

สำเนาถูกต้อง

๗

(สุโรชา โชคอำนวย)

วิศวกร

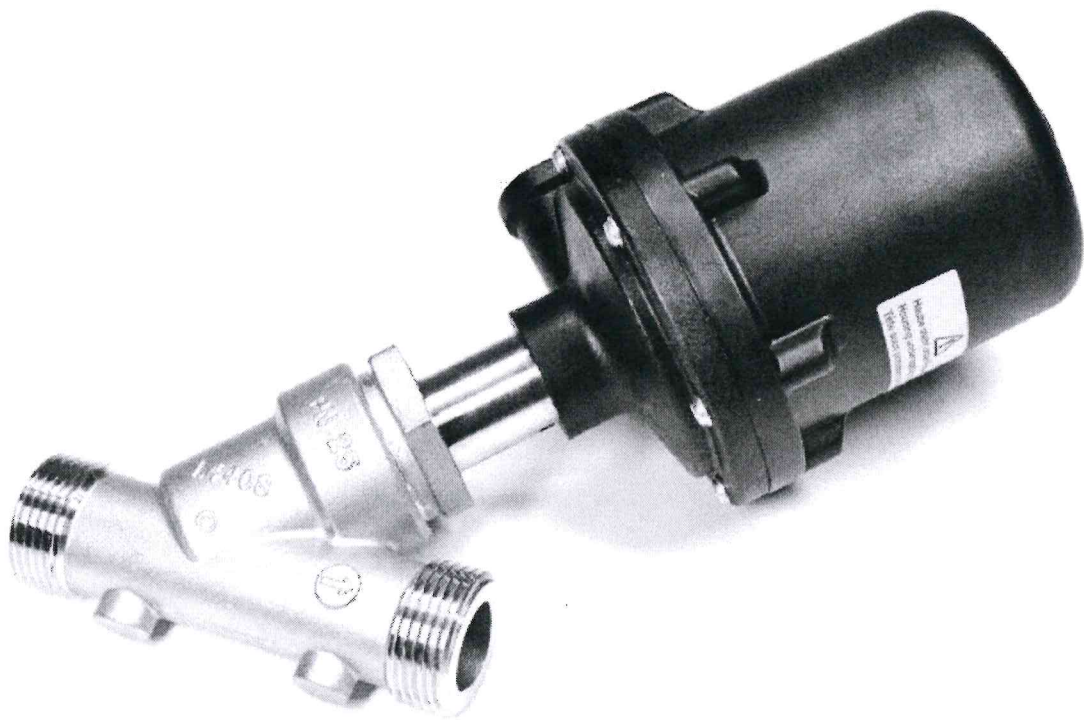

ชื่อพัสดุ

PISTON VALVE 1" SS OUT THRE
No. 570110102

รายละเอียด

- Piston valve ขนาด 1 นิ้ว ใช้กับเครื่องนึ่งยี่ห้อ "GETINGE"
- ชิ้นส่วนมีส่วนประกอบของพลาสติกและสแตนเลส
- ใช้โฟลัมในการควบคุมการทำงาน

เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 180 วัน นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

สำเนาถูกต้อง

ส

ศิริชา โชคอำนวย)

วิศวกร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อรายการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

จำนวน 5 หน่วยนับ งาน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ความต้องการ

จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 งาน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	รหัสครุภัณฑ์
1	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำระบบอัตโนมัติ	831000001463
2	เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ	831000002204
3	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ	831000000194
4	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ	831000001899
5	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ	831000001304

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีดังนี้

ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

3. คุณลักษณะทั่วไป

จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 งาน โดยการเปลี่ยนอะไหล่

4. คุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับ	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	รายการ
1	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วย ระบบไอน้ำระบบ อัตโนมัติ	831000001463	-HEATEXCHANGER CB 30-26H จำนวน 1 ตัว -SOLENOID VALVE 3-Way จำนวน 1 ตัว
2	เครื่องล้างเครื่องมือ แพทย์แบบอัตโนมัติ	831000002204	-SOLENOID VALVE, ASSY จำนวน 1 ชุด
3	เครื่องล้างเครื่องมือ อัตโนมัติ	831000000194	-FILTER DRYER จำนวน 1 ตัว -HOSE RUBBER WITH CHECK จำนวน 1 ตัว
4	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ	831000001899	-SWITCH PRESSURE จำนวน 1 ตัว
5	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ	831000001304	-HEAT EXCHANGER จำนวน 1 ตัว -PISTON VALVE จำนวน 1 ตัว

5. เงื่อนไขเฉพาะ (ถ้ามี)

- กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน
- กำหนดรับประกัน 180 วัน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



(นางสาวสโรชา โชคอำนวย)

ตำแหน่ง วิศวกร

ใบสั่งจ้าง

รหัสใบสั่งจ้าง : 3080008312/2568 - ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ถึง บริษัท เกททีงเค (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 06 มิถุนายน 2568

ตามที่ท่านได้เสนอรับจ้างทำการ ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 งาน ตามใบเสนอราคาเลขที่ - ของท่าน
ลงวันที่ 11.04.2025 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาแล้วตกลงจ้างท่านให้ทำการซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 งาน
คำบลศาลาษา อำเภอยุทธมณฑล นครปฐม

ให้ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบท้ายใบสั่งจ้างนี้ทุกประการโดยท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1	จ้างซ่อมเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ ด้วยระบบไอน้ำระบบอัตโนมัติ รหัสครุภัณฑ์ 831000001463 โดยมีรายละเอียดดังนี้ -HEATEXCHANGER CB 30-26H จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 56,496.- บาท -SOLENOID VALVE 3-Way จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 16,264.- บาท รวมเป็นเงิน 72,760.- บาท รับประกันสินค้า 180 วัน ตามใบเสนอราคาเลขที่ 8091030973 ลงวันที่ 11 เมษายน 2568	1.00 งาน	72,760	00	72,760	00
2	จ้างซ่อมเครื่องล้างเครื่องมือ แพทย์แบบอัตโนมัติ รหัสครุภัณฑ์ 831000002204 โดยมีรายละเอียดดังนี้ -SOLENOID VALVE, ASSY 9100E จำนวน 1 ชุด ตามใบเสนอราคาเลขที่ 8091030974 ลงวันที่ 11 เมษายน 2568	1.00 งาน	131,738	40	131,738	40
3	จ้างซ่อมเครื่องล้างเครื่องมือ อัตโนมัติ รหัสครุภัณฑ์ 831000000194 โดยมีรายละเอียดดังนี้ -FILTER DRYER 46-4/5 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 26,108.- บาท -HOSE RUBBER WITH CHECK จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 14,851.60 บาท รวมเป็นเงิน 40,959.60 บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ 8091031296 ลงวันที่ 11 เมษายน 2568	1.00 งาน	40,959	60	40,959	60
4	จ้างซ่อมเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ	1.00 งาน	34,496	80	34,496	80

	ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ รหัสครุภัณฑ์ 831000001899 โดยมีรายละเอียดดังนี้ -SWITCH PRESSURE-1++ BAR จำนวน 1 ตัว ตามใบเสนอราคาเลขที่ 8091031299 ลงวันที่ 11 เมษายน 2568					
5	จำซ่อมเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ รหัสครุภัณฑ์ 831000001304 โดยมีรายละเอียดดังนี้ -HEAT EXCHANGER CB14-10H จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 32,014.40 บาท -PISTON VALVE 1นิ้ว SS OUT THREAD จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 38,348.50 บาท รวมเป็นเงิน 70,363.20 บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ 8091031535 ลงวันที่ 11 เมษายน 2568	1.00 งาน	70,363	20	70,363	20
สามแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน			จำนวนเงินรวม		350,318	00

- ในการปฏิบัติตามใบสั่งจ้างนี้ ท่านจะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดี ใช้เครื่องมือดีและช่างฝีมือดี เพื่อประกอบการงานนี้จนแล้วเสร็จ
- งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะยอมรับ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ ตรวจสอบไว้เป็นการครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างแล้ว
- ในวันส่งมอบงานจ้าง ท่านจะต้องนำใบสั่งจ้างพร้อมหลักฐานการส่งงานมามอบให้ไว้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
- ท่านจะต้องส่งมอบงานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ภายในวันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2568
เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดลปรับเป็นรายวัน วันละ 351.- บาท
นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ
งานตามใบสั่งจ้างนี้เป็นวันเริ่มต้นจนถึงวันที่ท่านได้ส่งมอบงานจ้างให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลจนครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง
ทุกประการ
- เมื่องานเสร็จเรียบร้อยและมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบงานจากท่านแล้ว ถ้ามีเหตุชำรุดเสียหายเกิดแก่งานจ้างนี้ ภายใน - ปี - เดือน และ 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบงานโดยให้นับวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเหตุชำรุดเสียหายนั้น
เกิดจากความบกพร่อง ของท่านจะเป็นโดยทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือใช้ของที่ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาก็ตาม
ท่านจะต้องรีบทำการแก้ไขซ่อมแซม ให้เป็นที่เรียบร้อยภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น โดยไม่คิด ค่าสิ่งของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากมหาวิทยาลัยมหิดลอีก
- ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวไปยังผู้ขายหรือผู้รับจ้าง โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่อยู่ปรากฏ ไว้ในใบเสนอราคา/ตามสัญญา ถือว่าการแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวได้ส่งถึงผู้ขายโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ถ้างานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้น หลังจากระยะ เวลาที่กำหนดข้างต้น ท่านยังต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย

(ลงชื่อ) ผู้สั่งจ้าง
 (รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
 (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างฉบับนี้ไปและได้อ่านเข้าใจข้อความในใบสั่งจ้างนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติ
ตามข้อความในใบสั่งจ้างทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)ผู้รับใบสั่งจ้าง

(.....)

(ตำแหน่ง)

(ประทับตรา/บริษัท/ห้างฯ/ร้าน)

วันที่



04/6/68 12 GP

6/6/68

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ อว ๗๘.๐๗๓๕/พด ๐๗๓๗/๑ 03371 วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ งาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงจ้าง
๑. จ้างซ่อมเครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน	บริษัท เกทท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด	๗๒,๗๖๐.๐๐	๗๒,๗๖๐.๐๐
๒. จ้างซ่อมเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน	บริษัท เกทท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด	๑๓๑,๗๓๘.๔๐	๑๓๑,๗๓๘.๔๐
๓. จ้างซ่อมเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน	บริษัท เกทท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด	๔๐,๙๕๙.๖๐	๔๐,๙๕๙.๖๐
๔. จ้างซ่อมเครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน	บริษัท เกทท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด	๓๔,๔๙๖.๘๐	๓๔,๔๙๖.๘๐
๕. จ้างซ่อมเครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน	บริษัท เกทท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด	๗๐,๓๖๓.๒๐	๗๐,๓๖๓.๒๐
รวม			๓๕๐,๓๑๘.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
๒. ลงนามประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่เสนอมาพร้อมนี้
๓. ลงนามในใบสั่งจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

๒/๒/๒๘

๒

(นางศันสนีย์ โชคนาคะวโร)

นักวิชาการพัสดุ

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์

(นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)

หัวหน้างานพัสดุ

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

ศิริวัฒน์กุล

(แพทย์หญิงศุภวรรณ ศิริวัฒน์กุล) - ๖ มิ.ย. ๒๕๖๘

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ งาน โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ตามที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี
โครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จ้างซ่อมเครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บริษัท เกททีงเก (ไทยแลนด์) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๗๒,๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. จ้างซ่อมเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
เกททีงเก (ไทยแลนด์) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๑,๗๓๘.๔๐ บาท (หนึ่ง
แสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. จ้างซ่อมเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เกททีงเก (ไทย
แลนด์) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๙๕๙.๖๐ บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาท
หกสิบบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. จ้างซ่อมเครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
เกททีงเก (ไทยแลนด์) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๔๙๖.๘๐ บาท (สามหมื่น
สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง

๕. จ้างซ่อมเครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
เกททีงเก (ไทยแลนด์) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๓๖๓.๒๐ บาท (เจ็ดหมื่น
สามร้อยหกสิบบาทสี่สิบบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ใบปะหน้าส่งแฟกซ์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

888 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158378

ผู้ส่ง : นางคันฉรีย์ โขคนาคะวโร

ติดต่อ : ณ อาคารกาญจนาภิเษก งานพัสดุ ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ : 02-8496600 ต่อ 6383 / มือถือ : 097-1186999

เบอร์ FAX : 02-8496600 ต่อ 1100

E-mail: jeabkittys21@hotmail.com

(หากบริษัทได้รับแฟกซ์แล้วกรุณาส่งกลับหรือโทรแจ้ง เพื่อยืนยันการรับเอกสาร)

หมายเหตุ : * หากมียอดการสั่งจ้าง ตั้งแต่ 30,000.- บาท ขึ้นไป กรุณาเซ็นต์ตอบ
รับใบสั่ง และ แฟกซ์กลับ พร้อมนำเอกสารแนบมาด้วย อัตราเอกสารแนบ 1000
ละ 1 บาท

*หากมียอดการสั่งจ้าง / สั่งซื้อ ตั้งแต่ 200,000.- บาท ขึ้นไป กรุณา
เข้ามารับเอกสารต้นฉบับไป ทำการสลักหลัง ณ ที่สรรพากรอำเภอพุทธมณฑล
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ในใบสั่ง ***หากเกิน 15 วัน จะต้องเสียเบี้ยปรับ***

* กรณีทำสัญญา* กรุณา Fax เอกสารหนังสือคำประกันสัญญาก่อน
เข้ามาทำสัญญา เพื่อที่จะได้กรอกสัญญาเตรียมไว้ให้บริษัทเข้ามาทำสัญญา (หาก
เป็นไปได้ขอเป็นหนังสือคำประกัน เพื่อความสะดวกในการทำสัญญา)

***** ขอขอบคุณ ที่ให้ความร่วมมือทุกท่านค่ะ *****